

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-013/2022
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE
ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO**

1

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León siendo las **dieciséis horas con treinta minutos** del día **dos de diciembre del año dos mil veintidós**, en la Sala de Consejo del Instituto, ubicada en la calle Mariano Matamoros 319 poniente en el Centro de esta Ciudad; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria del procedimiento de licitación arriba mencionado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, 72 y 73 de su Reglamento, así como del numeral 6 de la convocatoria.

Presidiendo este acto el **Lic. Juan Enrique Villarreal Salazar**, Director de Administración del ISSSTELEON, servidor público designado por el **Lic. Luis Gerardo Gómez Guzmán**, Director General del ISSSTELEON, a través del memorándum número **DG-130/2022** de fecha **veinticuatro de noviembre del año dos mil veintidós**, quien procede a dar continuación a la sesión de junta de aclaraciones; así mismo, se hace constar que se cuenta con la presencia del Testigo Social asignado y acreditado por la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el Ciudadano **Licenciado José Saúl Cano Garza**.




PRIMERO.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM: Vista la lista de asistencia de la presente sesión se verifica y da fe por parte del Director Jurídico y representante del área jurídica del ISSSTELEON, el **Lic. Carlos Alberto Serna Gámez**, que de conformidad con el artículo 18, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, se encuentra presente la totalidad de los integrantes del Comité de Adquisiciones con derecho a voz y voto, así como los invitados a esta junta de aclaraciones, por lo que los acuerdos tomados en la presente sesión son válidos y subsistentes para todos los efectos legales.

SEGUNDO.- ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES: El Presidente del acto, hace constar que de conformidad al artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y el numeral 5 de la convocatoria, se recibieron en tiempo y forma las solicitudes de aclaración, así como el escrito de interés en participar del siguiente licitante:



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000

@gob_Nuevo León   

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-013/2022
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE
ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO**

2

No.	Nombre (Razón o Denominación Social)	Número de solicitudes de aclaración
1	DICIPA, S.A. DE C.V.	20
TOTAL DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN		20

Acto seguido, se procede a la lectura de las solicitudes de aclaración a la convocatoria, presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la convocante, como se indica a continuación:

DICIPA, S.A. DE C.V.

B. PREGUNTAS TÉCNICAS



Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
1	ANEXO 2 ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS, EQUIPO ANALIZADOR DE COAGULACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO.	DE ACUERDO AL NUMERO DE PRUEBAS REPORTADOS SOLICITAMOS SE PUEDA OFERTAR INSTRUMENTO SEMIAUTOMATIZADO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: INSTRUMENTO SEMIAUTOMATIZADO. CON DOS CANALES DE MEDICIÓN. METODOLOGÍA OPTO MECÁNICA VELOCIDAD DE 60 TP POR HORA PRUEBAS TP, TPT, FIB Y PRUEBAS ESPECIALES, BLOQUE DE INCUBACIÓN DE 30 COPAS. 4 POSICIONES DE REACTIVOS. TROMBOPLASTINA DE ORIGEN HUMANO MENOR O IGUAL A 1.2. ESTAS CARACTERÍSTICAS NO AFECTAN LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS Y SE GARANTIZA EL SERVICIO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	No se acepta su propuesta. El equipo ofertado deberá contar como mínimo con 4 canales de medición y pipeta controlada electrónicamente



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-013/2022
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE
ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO**

3

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
2	FICHA TÉCNICA A: EQUIPOS EN COMODATO, LISTADO DE ESTUDIOS: AC. ANI CHIKUNGUNYA AC. ANI DENGUE IGG, IGM, NS1 AC. ANI ZIKA AC. ANTI HELICOBACTER PYLORI HELICOBACTER PYLORI	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DEBIDO AL BAJO VOLUMEN DE LAS PRUEBAS MENCIONADAS NOS PERMITA OFERTAR PRUEBA RÁPIDA GARANTIZANDO AL INSTITUTO LA CONFIABILIDAD EN LOS RESULTADOS. ¿SE ACEPTA?	Se acepta la propuesta 
3	FICHA TÉCNICA A: EQUIPOS EN COMODATO, LISTADO DE ESTUDIOS: SANGRE OCULTA EN HECES PRUEBA DE EMBARAZO PRUEBA DE ROTAVIRUS CAJA C/20 REACCIONES FEBRILES ROTAVIRUS VDRL ó RPR ANTIDOPING	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS PRUEBAS MENCIONADAS SE REQUIEREN EN FORMATO DE PRUEBA RÁPIDA O MANUAL. FAVOR DE ACLARAR.	Se refiere a prueba rápida 
4	FICHA TÉCNICA A: EQUIPOS EN COMODATO, LISTADO DE ESTUDIOS: BAAR EN ESPUTO/ORINA TINCION DE GRAM KOH	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS PRUEBAS ENLISTADAS DEBEN SER CONSIDERADAS PARA SU PROCESO EN FORMA MANUAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Es correcta su apreciación .Se refiere a proceso manual





**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-013/2022
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE
ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO**

4

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
5	FICHA TÉCNICA A: EQUIPOS EN COMODATO, LISTADO DE ESTUDIOS: BAAR EN ESPUTO/ORINA TINCION DE GRAM KOH	EN CASO DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS INDIQUE CUALES SON LOS INSUMOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR ENTREGAR PARA EL PROCESO DE ESTAS PRUEBAS A FIN DE ESTABLECER UNA PROPUESTA ECONÓMICA ADECUADA. FAVOR DE ACLARAR.	Kit de tinción rápida, para BAAR y Gram y reactivo para KOH con 100 pruebas. Resaltando que el pago es por prueba efectiva
6	FICHA TÉCNICA A: EQUIPOS EN COMODATO, LISTADO DE ESTUDIOS: ANTIDOPING	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTA PRUEBA NOS PERMITA OFERTAR: PRUEBA EN FRASCO PARA DETERMINAR 6 DROGAS AMP, BZD, COC, MET, OPI Y THC ¿SE ACEPTA?	Se acepta la propuesta. Prueba rápida con 6 determinaciones
7	Guía de Equipamiento CENETEC Página 8 Numeral 4. Equipamiento por área 533.342.1385 Urianálisis	En este apartado se menciona un numeral de cuadro básico del Diario Oficial, entendemos que estas especificaciones son las que se referenciarán, ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación
8	Diario Oficial Página 78 (Primera Sección) 533.342.1385 Uroanálisis Software en español	En caso de que sea correcta la apreciación de la pregunta anterior, solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita ofertar iconos de fácil comprensión. ¿Se acepta?	Se acepta la propuesta
9	Diario Oficial Página 78 (Primera Sección) 533.342.1385 Uroanálisis Depósito de muestras	Entendemos que "Depósito de muestras" se refiere a Lado de carga de racks de muestras, ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta la apreciación
10	Guía de Equipamiento CENETEC Página 8 Numeral 4. Equipamiento por área 533.342.1427 Microbiología	En este apartado se menciona un numeral de cuadro básico del Diario Oficial, entendemos que estas especificaciones son las que se referenciarán, ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta la apreciación



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-013/2022
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE
ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO**

5

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
11	8.2.24 Todos los requisitos adicionales y/o documentación complementaria solicitada en la Ficha Técnica	Con la finalidad de garantizar el total abastecimiento de los equipos ofertados para el procesamiento de pruebas, calidad y continuidad de los servicios objeto de la presente licitación. Solicitamos a la convocante considerar como requisito indispensable carta de apoyo de los equipos analizadores, emitida por el fabricante, titular de los registros sanitarios y/o Filial en México en papel membretado y firma autógrafa del representante legal o de la persona autorizada para ello.	Se deberá de integrar a la propuesta técnica la carta de apoyo del fabricante
12	8.2.16. Curriculum	Con la finalidad de que la convocante obtenga certeza del cumplimiento consistente de requerimientos regulatorios y evidencia de la gestión del sistema de calidad de la entrega total de los bienes en tiempo y forma, así como la experiencia por parte del licitante que resulte adjudicado. solicitamos a la convocante considerar como requisito y parte de la propuesta la certificación ISO 13485:2016 a nombre del licitante el cual demostró ante un organismo certificador (EMA), contar con un sistema de gestión de la calidad para el almacenamiento, distribución y la capacidad para proporcionar dispositivos médicos y servicios relacionados.	La pregunta no está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria que contiene las bases de la licitación, por lo que, en virtud de lo anterior, se desecha su pregunta con fundamento en lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León
13	8.2.24 Todos los requisitos adicionales y/o documentación complementaria solicitada en la Ficha Técnica	Con la finalidad de garantizar la calidad y seguridad que deben de cumplir los equipos ofertados para ser comercializados, éstos requieren para su venta o suministro en el país contar con la autorización sanitaria correspondiente, misma que adopta la modalidad de registro sanitario; de acuerdo a lo señalado en el Artículo 262 fracción I y 376 de la ley general de salud. Por lo antes expuesto, entendemos que es requisito la entrega de registro sanitario de los equipos analizadores objeto de esta licitación toda vez que este documento avala la autorización de la autoridad sanitaria en México, la COFEPRIS, cumpliendo los requisitos para demostrar que el dispositivo médico reúne las características para ser comercializado en el Sector Salud Mexicano.	Se deberá de integrar a la propuesta técnica todos los registros sanitarios vigentes, de cada uno de los equipos ofertados

kt



Handwritten signatures and initials in blue ink.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-013/2022
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE
ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO**

6

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta								
14	A. EQUIPOS EN COMODATO • Los equipos en comodato deberán cumplir con las Cédulas de Especificaciones Técnicas de Equipo Médico establecidas por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC)	De acuerdo con la Guía de Equipamiento, Unidad de Laboratorio Clínico con Volumen de Procesamiento Alto de CENETEC Versión Para Revisión junio 30 del 2005 G.E. UCA 02, V.02 VI.05, en su anexo 2, no menciona especificaciones de equipos para Gases en Sangre, solicitamos a la convocante nos indique las especificaciones que serán consideradas para referenciar el equipo a ofertar. Favor de pronunciarse.	El equipo deberá de procesar como mínimo los siguiente analitos: pH, PCO2, PO2, hematocrito, Na, K, Cl, Ca, Glucosa y lactato								
15	A. EQUIPOS EN COMODATO • Los equipos en comodato deberán cumplir con las Cédulas de Especificaciones Técnicas de Equipo Médico establecidas por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC)	<p>Hacemos mención que, en la Guía de Equipamiento, Unidad de Laboratorio Clínico con Volumen de Procesamiento Alto de CENETEC Versión Para Revisión junio 30 del 2005 G.E. UCA 02, V.02 VI.05 menciona en su anexo 2 lo siguiente:</p> <p>Anexo 2. Especificaciones de los equipos</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Equipo</th> <th>Metodología Empleada</th> <th>Grado de automatización</th> <th>Tiempo efectivo de proceso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analizador de bioquímica clínica</td> <td>Fotometría</td> <td>Automatizado</td> <td>180 minutos</td> </tr> </tbody> </table> <p>Por otra parte, también menciona en el punto 4. Equipamiento por área: Química clínica con clave: 533.036.0701, Analizador de Bioquímica Clínica alto rendimiento</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante se sirva aclarar qué especificaciones debemos considerar para la referencia de los analizadores a ofertar las mencionadas en el anexo 2 o las mencionadas en la ficha de cuadro básico: 533.036.0701</p>	Equipo	Metodología Empleada	Grado de automatización	Tiempo efectivo de proceso	Analizador de bioquímica clínica	Fotometría	Automatizado	180 minutos	Apegarse a lo solicitado en convocatoria, ficha técnica y anexos.
Equipo	Metodología Empleada	Grado de automatización	Tiempo efectivo de proceso								
Analizador de bioquímica clínica	Fotometría	Automatizado	180 minutos								
16	A. EQUIPOS EN COMODATO • Los equipos en comodato deberán cumplir con las Cédulas de Especificaciones Técnicas de Equipo Médico establecidas por el Centro	En caso de que su respuesta sea el emplear las Cédulas de Especificaciones Técnicas de Equipo Médico establecidas por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC).	Apegarse a lo solicitado en convocatoria, ficha técnica y anexos								



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-013/2022
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE
ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO**

7

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración				Respuesta
	Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC)	Equipo	Metodología Empleada	Grado de automatización	Tiempo efectivo de proceso	
		Analizador de bioquímica clínica	Fotometría	Automatizado	180 minutos	
		Solicitamos a la convocante permita que en la característica "Tiempo efectivo de proceso" se coloque la velocidad de procesamiento por hora del analizador ofertado. Favor de pronunciarse.				
17	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 1.- REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO	Solicitamos amablemente a la convocante se sirva aclarar a que periodo de tiempo corresponden el menú de pruebas solicitado en este apartado. Páginas 2 a 6.				El periodo es del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
18	FICHA TÉCNICA REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO 2023 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A. EQUIPOS EN COMODATO	Solicitamos amablemente a la convocante indique el número de analizadores que requiere para cada área.				Los analizadores necesarios para cumplir con los estudios descritos en la ficha técnica de la presente licitación.
19	Ficha técnica Reactivos para Laboratorio y equipos en Comodato 2023 Punto A Equipos en Comodato estudios a realizar	Con la finalidad de presentar una propuesta solvente, solicitamos amablemente a la convocante, se permita enviar a un laboratorio de Referencia Certificado bajo la norma NMX-EC-15189-IMNC-2015 / ISO 15189:2012. asegurando la calidad de los resultados, aquellos estudios de bajo requerimiento enlistados en la "ficha técnica Reactivos para Laboratorio y equipos en Comodato 2023", contemplando que la recepción, embalaje, traslado de muestras y procesamiento de estudios, así como el envío de resultados, correrá por cuenta del Licitante Adjudicado, sin costo adicional para el Instituto. ¿Se acepta?				No se acepta la propuesta. Apegarse a lo solicitado en la ficha técnica de la presente licitación en la cual los equipos se ubicaran en Centro Médico ISSSTELEON y por lo tanto la realización de estudios.



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-013/2022
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE
ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO**

8

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
20	Guía de equipamiento Unidad de Laboratorio Clínico con Volumen de Procesamiento Alto Anexo 2 especificaciones de los equipos CENETEC Tiempo efectivo de proceso	Es correcto entender que los tiempos de proceso solicitados, en cada uno de los instrumentos, se refiere ¿al tiempo de proceso de cada muestra? Favor de pronunciarse.	Se refiere al tiempo de proceso de cada analito

Se informa que las solicitudes de aclaración fueron solventadas por la Directora de Servicios Médicos, la Dra. Ma. Guadalupe Garza Sagástegui, cuya firma aparece al final de la presente acta, así como con el apoyo del personal a su cargo del ISSSTELEON.

TERCERO.- CIERRE DEL ACTA: De conformidad con el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, esta acta forma parte integrante de la convocatoria y deberá de ser considerada por los licitantes en la elaboración de sus propuestas.

Asimismo, para efectos de la notificación y en términos del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, en la página WEB del ISSSTELEON (<http://www.isssteleon.gob.mx>), la presente acta.

A su vez, se recuerda a los licitantes que el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas se llevará a cabo el día **doce de diciembre del año dos mil veintidós a las dieciséis horas con treinta minutos** en este mismo lugar.

No existiendo aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada esta junta, siendo las **dieciséis horas con cincuenta y dos minutos** del día al inicio señalado, levantándose el



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000

@gob_Nuevo León   

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-013/2022
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE
ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO**

9


acta correspondiente, firmando la misma para constancia y efectos legales que le son inherentes, las personas que intervinieron en este acto y así quisieron hacerlo, sirviendo la presente acta de notificación legal, entregándose copia de la misma a cada uno de los presentes.

Miembros del Comité de Adquisiciones del ISSSTELEON

Con voz y voto:


Lic. Juan Enrique Villarreal Salazar

*Director de Administración del ISSSTELEON
En representación del Lic. Luis Gerardo Gómez Guzmán,
Director General del ISSSTELEON*

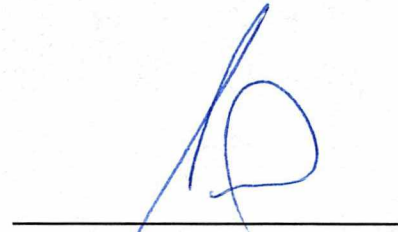

Lic. Juan Silvano Hernández Sena

*En representación de la Secretaría de Administración del
Estado de Nuevo León*

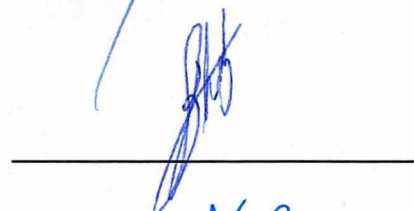

Lic. Carlos Alberto Serna Gámez


*Director Jurídico y representante
del área jurídica del ISSSTELEON*



Sólo con voz:

Lic. Verónica Elizabeth Santana Torres

*Representante de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León*

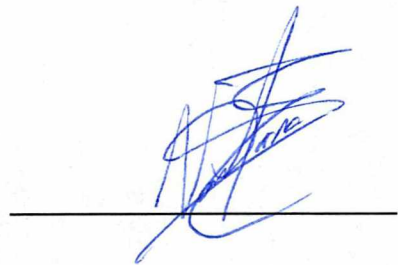

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-013/2022
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE
ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO**

10

“Dejando salvaguardadas las facultades de verificación y comprobación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental”

Dra. Ma. Guadalupe Garza Sagástegui

Directora de Servicios Médicos

Representante del área que requirió el bien y/o servicio



Lic. José Saúl Cano Garza

Testigo Social



Por los licitantes


DICIPA, S.A. DE C.V.

C. José Alfredo Soto Alonso



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN****LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-013/2022
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE
ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO**



Monterrey, Nuevo León a 02 de diciembre de 2022.

1	
NOMBRE DEL LICITANTE:	<u>DICIPA SA de CV</u>
REPRESENTANTE LEGAL:	<u>Samuel Urbaz Lopez</u>
NOMBRE DE LA PERSONA QUE SE PRESENTA A LA JUNTA DE ACLARACIONES:	<u>José Alfredo Soto Alonso</u>
FIRMA:	<u></u>
CORREO ELECTRÓNICO:	<u>alfredo.soto@dicipa.com.mx</u>
2	
NOMBRE DEL LICITANTE:	_____
REPRESENTANTE LEGAL:	_____
NOMBRE DE LA PERSONA QUE SE PRESENTA A LA JUNTA DE ACLARACIONES:	_____
FIRMA:	_____
CORREO ELECTRÓNICO:	_____



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN****LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-013/2022
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE
ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO**

Monterrey, Nuevo León a 02 de diciembre de 2022

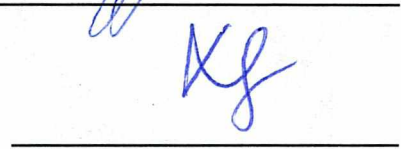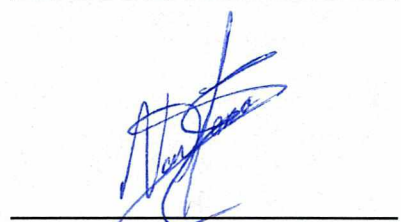Miembros del Comité de Adquisiciones del ISSSTELEON**Con voz y voto:****Lic. Juan Enrique Villarreal Salazar***Director de Administración del ISSSTELEON**En representación del Lic. Luis Gerardo Gómez Guzmán,
Director General del ISSSTELEON***Lic. Juan Silvano Hernández Sena***En representación de la Secretaría de Administración del
Estado de Nuevo León***Lic. Carlos Alberto Serna Gámez***Director Jurídico y representante
del área jurídica del ISSSTELEON***Sólo con voz:****Lic. Verónica Elizabeth Santana Torres***Representante de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León***Dra. Ma. Guadalupe Garza Sagástegui***Directora de Servicios Médicos
Representante del área que requirió el bien y/o servicio***Lic. José Saúl Cano Garza***Testigo Social*