

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

1

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León siendo las **once horas** del día **primero de diciembre del año dos mil veintitrés**, en la Sala de Consejo del Instituto, ubicada en la calle Mariano Matamoros 319 poniente en el Centro de esta Ciudad; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria del procedimiento de licitación arriba mencionado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, 72 y 73 de su Reglamento, así como del numeral 6 de la convocatoria de licitación.

Presidiendo este acto el **Lic. Juan Enrique Villarreal Salazar**, Director de Administración del ISSSTELEON, servidor público designado por el **Lic. Luis Gerardo Gómez Guzmán**, Director General del ISSSTELEON, a través del memorándum número **DG-072/2023** de fecha **veintiuno de noviembre del año dos mil veintitrés**, quien procede a dar continuación a la sesión de junta de aclaraciones; informando a los licitantes presentes que de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, de forma presencial y cuyas preguntas hayan sido recibidas con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas. Así mismo, se hace constar que se cuenta con la presencia del Testigo Social asignado y acreditado por la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la Ciudadana **Ruth Magdalena González Góngora**.

PRIMERO.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM: Vista la lista de asistencia de la presente sesión se verifica y da fe por parte del Subdirector Jurídico Consultivo y suplente del representante del área jurídica del ISSSTELEON, el **Lic. Guillermo Zamora Garza**, que de conformidad con el artículo 18, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, se encuentra presente la totalidad de los integrantes del Comité de Adquisiciones con derecho a voz y voto, así como los invitados a esta junta de aclaraciones, por lo que los acuerdos tomados en la presente sesión son válidos y subsistentes para todos los efectos legales.

SEGUNDO.- ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES: El Presidente del acto, hace constar que de conformidad al artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81)

2033.9000@gob_Nuevo León



R

J
R
R
y
T
A

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

2

de Nuevo León y el numeral 6 de la convocatoria, se recibieron en tiempo y forma las solicitudes de aclaración, así como el escrito de interés en participar de las siguientes personas:

No.	Nombre (Razón o Denominación Social)	Número de solicitudes de aclaración
1	BIODIST, S.A. DE C.V.	47
2	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	21
3	IGSA MEDICAL SERVICES, S.A. DE C.V.	10
TOTAL DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN		78

Acto seguido, se procede a la lectura de las solicitudes de aclaración a la convocatoria, presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la convocante, como se indica a continuación:

BIODIST, S.A. DE C.V.

A. PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
1	DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. Punto 8.2.8.	Es correcto entender que para cumplir este punto, basta que la empresa, así como el servicio sea de nacionalidad mexicana, y que los equipos, reactivos y bienes de consumo, podrán ser nacionales o internacionales BTLC, sin que esto afecte al porcentaje mínimo de contenido nacional, ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta siempre y cuando presente los permisos de importación
2	DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. Punto 8.2.12.	Se solicita amablemente a la convocante que para el cumplimiento de este punto podamos entregar última factura de arrendamiento, ya que este incluye todos los servicios solicitados, sin que sea esto causal de desechamiento, ¿se acepta?	Se podrá presentar copia simple del contrato de arrendamiento a nombre del licitante junto con copia de la última factura de arrendamiento.



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81)

2033.9000@gob_Nuevo León



[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and marks]

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

3

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
3	DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. Punto 8.2.13.	Se solicita amablemente a la convocante que podamos presentar la declaración fiscal provisional de Septiembre y Octubre, ya que la cubre el mes de Noviembre, porque mi representada no la generan la declaración hasta el 17 del siguiente mes, por lo que no se podría incluir en la propuesta final, ¿Se acepta?	Deberá de presentarse la del mes de octubre de 2023.
4	30. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE ANEXOS Párrafo Primero	Se solicita amablemente a la convocante, para el cumplimiento de este punto, toda la documentación (Como Certificados de capacitación, Manuales, folletos, etc.) que este en un idioma diferente al español, se pueda presentar con traducción simple, ya que existe una diferencia con lo que solicita en punto DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. Punto 8.2.25. ¿Se acepta?	No se acepta la propuesta. Los Certificados de capacitación, Manuales y Folletos deben ser en español.
5	Anexo 22 FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE DE QUE CONTENDRÁ LA PROPUESTA TÉCNICA Punto 8.2.13.	Se solicita amablemente a la convocante que podamos presentar la declaración fiscal provisional de Septiembre y Octubre, ya que la cubre el mes de Noviembre, porque mi representada no la generan la declaración hasta el 17 del siguiente mes, por lo que no se podría incluir en la propuesta final, ¿Se acepta?	Pregunta repetida. Deberá de presentarse la del mes de octubre de 2023.
6	Anexo 22 FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE DE QUE CONTENDRÁ LA PROPUESTA TÉCNICA Punto 8.2.18.	Se solicita amablemente a la convocante que las opiniones positivas Federales y Estatales, sean de Noviembre, ya que existe una diferencia con lo que solicita en punto DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. Punto 8.2.18. ¿Se acepta?	Deberán presentarse los documentos de acuerdo con lo señalado en el numeral 8.2.18 de la convocatoria



k

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

4

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
7	FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE TÉCNICO Y EL ECONÓMICO. Punto 8.2.25.	Se solicitan anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante completos, para comprobar las especificaciones técnicas requeridas. Con el fin de optimizar la presentación de la información a la convocante, solicitamos amablemente nos permita presentar solo las páginas con secciones y/o párrafos debidamente referenciados que soporten las especificaciones y propuesta técnica. ¿Se acepta?	NO se acepta debe presentar en forma específica lo solicitado en la ficha técnica.

B. PREGUNTAS TÉCNICAS

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
1	REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA LICITACIÓN 2024, NUMERALES 39 Y 40 GRUPO COAGULACIÓN ESPECIAL	Solicitan Anticoagulante lúpico 230 máximas anuales lo que significa menos de 1 prueba diaria, en el caso de Dimero D solicitan como máximo 53 pruebas anuales que es igual menos de 1 prueba al día, por lo que solicitamos que estas pruebas se puedan enviar a maquilar, y así evitar precios elevados de las mismas y perjudique al instituto. ¿Se acepta?	Apegarse a las especificaciones de la ficha técnica en lo relativo a las condiciones de procesamiento de los estudios.
2	NUMERAL 8.2.25, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO, EQUIPO HEMATOLOGÍA, NUMERAL 18.	Solicitan Instalación: Corriente eléctrica 120V / 60 Hz, es correcto entender que se puede ofrecer un instrumento que tenga un rango entre 90-240 v/48-62 hz? Ya que esto cubre con el voltaje y Hz solicitados, favor de pronunciarse.	Es correcta su apreciación



Handwritten signatures and initials in blue ink.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

5

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
3	NUMERAL 8.2.25, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO, EQUIPO COAGULACIÓN	<p>Solicitan Características de un instrumento de coagulación de alto rendimiento, sin embargo, el número de pruebas es bajo, por lo que solicitamos se acepte un instrumento semi automatizado con las siguientes características, para evitar que el precio de la prueba sea elevado y perjudique a la institución:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analizador semiautomatizado para la determinación de reacciones de coagulación, cromogénicas e inmunológicas. 2. Que realice las pruebas de TP, TPT, Fibrinógeno, Factores, y Dimero D. 3. Principio de medición Foto- óptico, opto mecánico. 4. Rendimiento de pruebas 60/h PT (2 canales), 30/h APTT (2 canales) 5. Software en español. 6. Métodos programados: PT, en segundos, %, Razón INR (combinaciones) 7. Fuente de luz LED (diodo emisor de luz), 405 nm 8. Pantalla: 2 líneas con 20 caracteres cada una, pantalla de cristal líquido 9. Procesador: ARM Cortex M4 (microcontrolador, chip único) 10. Bloque de incubación controlado a 37,4 °C +/- 0,4 °C 11. Canales de medición 2 12. Viales de reactivo 4 posiciones. 13. Posiciones de cubeta 18 (2 canales) para incubación de muestra 14. Interfaces RS232-C, USB, tarjeta SD + lector para ChipCARD, 15. Impresora Impresora térmica interna, 26 caracteres/línea 16. ELECTRICIDAD: 100 – 240 VAC, 2.5 - 1.0 A, 50-60 Hz <p>Favor de pronunciarse.</p>	<p>Apegarse a las especificaciones técnicas de equipamiento solicitado de tipo automatizado.</p>



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81)

2033.9000@gob_Nuevo León



Handwritten mark

Handwritten signatures and marks

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

6

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
4	<p>3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO</p> <p>EQUIPO HORMONAS Y MARCADORES TUMORALES</p> <p>2. Capacidad de procesamiento de muestras por hora: entre 200 -400 estudios/ hora</p>	<p>Solicitan en el punto 2, capacidad de procesamiento de muestras por hora entre 200-400 estudios/hora</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante que se nos permita ofertar un equipo analizador, con una capacidad de 170 -340 muestras por hora, garantizando el proceso y entrega de resultados oportuno. Siendo que esta es la capacidad de muestra que actualmente se utiliza en el hospital, por lo que permitiría mejorar la propuesta económica y no encarecerla.</p> <p>Favor de pronunciarse</p>	<p>Es necesario que se apege a las especificaciones solicitada en el punto 2 relacionada con la capacidad de procesamiento de estudios /hora.</p>
5	<p>FICHA TÉCNICA</p> <p>REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO 2024</p> <p>CONSIDERACIONES PARA LOS ESTUDIOS</p> <p>Procesar los estudios en cualquiera de los equipos que oferte.</p>	<p>Conforme a lo descrito en la Ficha técnica, consideraciones para los estudios, en donde se permite procesar los estudios en cualquiera de los equipos ofertados.</p> <p>Por lo que, en caso de ofertar un equipo para procesar los estudios de Hormonas y Marcadores Tumoraes, se permita procesar en el mismo equipo los estudios de Serología y Serología especial. Con ello se podrá optimizar y simplificar el proceso del área usuaria, y no encarecer la propuesta por equipamiento extra. Será correcto entender que se podrá omitir la referencia de la cedula de las características de Serología y Serología especial</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>Se acepta la propuesta</p>
6	<p>3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO</p> <p>Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado</p>	<p>Solicitamos amablemente a la convocante que para dar cumplimiento con este punto en los equipos, se nos permita presentar una carta compromiso bajo protesta de decir verdad, que cumpliremos con los solicitado.</p> <p>Favor de pronunciarse</p>	<p>Se acepta la propuesta</p>



Handwritten mark

Handwritten signatures and marks

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

7

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
7	Ficha Técnica Especificaciones para los Gases en sangre.	Se solicita amablemente a la convocante se acepte equipo que determine los siguientes parámetros: pH, PCO2, PO2, Hct, Na+, K+, Cl-, iCa, Glucosa y Lactato, parámetros de utilidad medica que son actualmente utilizados en el instituto en el diagnóstico de anomalías en el equilibrio acido-base del paciente. ¿Se acepta?	Se acepta la propuesta
8	Ficha Técnica Especificaciones para los Gases en sangre.	Se requiere equipo con puerto de comunicación para interfase, se solicita amablemente a la convocante que se acepte carta compromiso bajo protesta de decir verdad que el equipo ofertado cuenta con puerto que permite la comunicación para la interfaz del laboratorio. ¿Se acepta?	No se acepta. Es indispensable apearse a las especificaciones para los gases en sangre.
9	Ficha Técnica Especificaciones para los Gases en sangre.	Se requiere equipo con regulador de voltaje y batería de respaldo. Se solicita a la convocante se acepta carta compromiso bajo protesta de decir verdad que se ofertara equipo No break el cual cumple con las funciones solicitadas. ¿Se acepta?	No se acepta. Es indispensable apearse a las especificaciones para los gases en sangre
10	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO	Se solicita amablemente a la convocante nos permita presentar carta compromiso bajo protesta de decir verdad para los puntos que por su naturaleza no se pueden referenciar en catálogos o manuales del equipo, comprometidos a cumplir con lo solicitado. ¿Se acepta?	No se acepta, es indispensable cumplir con las especificaciones técnicas del equipo solicitado y descrito en ficha técnica.
11	Especificaciones en Uroanálisis Grupo de Uroanálisis Estudios incluidos: 1.- Examen General de Orina	Entendemos que el Sedimento Urinario se realizará de manera manual mediante el reactivo de tinción Sternheimer-Malbin, En caso de requerir algún bien de consumo adicional, podrá especificarlo para su correcta propuesta económica ¿es correcta nuestra apreciación, favor de pronunciarse?	Le solicitamos apearse a lo solicitado en la ficha técnica en relación a los bienes de consumo necesarios
12	3.- Especificaciones Técnicas del Equipamiento EQUIPO UROANÁLISIS 5. Depósito de muestras	Entendemos que "Depósito de muestras" se refiere a Lado de carga de racks de muestras, ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81)

2033.9000@gob_Nuevo León



Handwritten signatures and initials in blue ink.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

8

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
13	REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA LICITACIÓN 2024 No. 82 Grupo Microbiología	Identificación y sensibilidad de Levaduras Debido a la baja productividad y con la finalidad de no encarecer la propuesta económica, solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita enviar esta prueba a un laboratorio de referencia, ¿se acepta?	No se acepta su propuesta. Todo estudio en cuanto a su procesamiento deberá apearse a las condiciones y especificaciones descritas en la ficha técnica.
14	3.- Especificaciones Técnicas del Equipamiento EQUIPO MICROBIOLOGÍA	Sistema automatizado para la identificación y susceptibilidad de bacterias y/o levaduras presentes en muestras biológicas (estériles o contaminadas) de pacientes o ambientales. Debido a la baja productividad y con la finalidad de no encarecer la propuesta económica, solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita ofertar Sistema Semi- Automatizado para la Identificación y/o susceptibilidad de bacterias y/o levaduras presentes en muestras biológicas (estériles o contaminadas) de pacientes o ambientales, ¿se acepta?	No se acepta la propuesta
15	3.- Especificaciones Técnicas del Equipamiento EQUIPO MICROBIOLOGÍA	2. Preparación, incubación, adición de reactivos automatizado. Solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita ofertar Preparación, incubación, adición de reactivos manual. ¿Se acepta?	No se acepta la propuesta
16	3.- Especificaciones Técnicas del Equipamiento EQUIPO MICROBIOLOGÍA PARA DETECCIÓN DE CRECIMIENTO MICROBIANO (HEMOCULTIVO)	Debido a que no existen pruebas de hemocultivos en el Requerimiento de Estudios de Laboratorio para la Licitación 2024 ni en el anexo 19 Propuesta económica, entendemos que esta ficha no aplicaría y que no se deberá ofertar equipo de hemocultivos, ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación, no se ofertará equipo.
17	3.- Especificaciones Técnicas del Equipamiento EQUIPO MICROBIOLOGÍA PARA DETECCIÓN DE CRECIMIENTO	En caso de ser negativa la respuesta a la pregunta anterior, solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita enviar las pruebas de hemocultivos a un laboratorio de referencia, ¿se acepta?	No se acepta, no existen pruebas de hemocultivo en el requerimiento de ficha técnica



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81)

2033.9000@gob_Nuevo León



Handwritten signatures and marks in blue ink.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

9

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
	MICROBIANO (HEMOCULTIVO)		
18	8.2. DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. 8.2.26. CARTA DE APOYO O RESPALDO,	Solicitamos amablemente a la convocante se sirva aclarar si es correcto entender que tratándose del Microscopio y la Centrifuga solicitados, al ser considerados equipos complementarios o periféricos no será necesario presentar esta carta de apoyo, ¿es correcta nuestra apreciación?	No es correcta su apreciación. Es necesario presentar carta de apoyo o respaldo solicitado en el numeral 8.2.26
19	8.2. DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. 8.2.28. Copias simples de constancias o certificados por parte del fabricante de los equipos expedidos a nombre del personal de soporte técnico,	Solicitamos amablemente a la convocante que para la Centrifuga y el Microscopio, al ser considerados equipos complementarios, no sean requeridas estas constancias y nos permita presentar una carta bajo protesta de decir verdad que contamos con personal capacitado para dar soporte técnico a estos equipos. ¿se acepta?	No se acepta, es necesario apegarse a lo estipulado en la ficha técnica en el numeral 8.2.28
20	FICHA TÉCNICA EQUIPO. CENTRIFUGA 4. Freno automático	Solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar una centrifuga que cuente con freno automático o con tiempo de frenado. ¿se acepta?	Se acepta la propuesta
21	FICHA TÉCNICA EQUIPO. CENTRIFUGA 2. Tacómetro	Solicitamos amablemente a la convocante se sirva aclarar si es correcto entender que con Tacómetro se refieren a que la centrifuga cuente con un Display donde pueda observarse las revoluciones por minuto (RPM) y el tiempo. ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81)

2033.9000@gob_Nuevo León



Handwritten signatures and marks in blue ink.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

10

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
22	FICHA TÉCNICA EQUIPO. CENTRIFUGA 3. Opera con presión de detenido automático	Solicitamos amablemente a la convocante se sirva aceptar una centrífuga que cuente con un botón de MARCHA/PARO el cual su función es activar o detener las funciones de la centrífuga. ¿se acepta?	Se acepta
23	FICHA TÉCNICA EQUIPO. CENTRIFUGA 6. Opera por tiempo y forma continua.	Solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar una centrífuga con tiempo programable dentro del rango de 1 segundo a 99 minutos 59 segundos. ¿se acepta?	Se acepta
24	FICHA TÉCNICA 8. Control de posicionamiento coaxial "XY" con desplazamiento mínimo de 78 x 54 mm.	Solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar un microscopio con un desplazamiento mínimo de 75x40 siendo este un rango óptimo para desplazar las laminillas que se emplean en el laboratorio clínico. ¿Se acepta?	Se acepta la propuesta
25	FICHAS TÉCNICAS. Renglón 92. Pruebas Especiales, Anticuerpos Anti-reaginas (V.D.R.L.)	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar esta prueba para su proceso de forma manual ya que en la actualidad no hay equipos automatizados que puedan procesarla. ¿se acepta?	Apegarse a lo especificado en la ficha técnica en lo relacionado a pruebas especiales
26	FICHAS TÉCNICAS. Pruebas Especiales, Renglón 92., Anticuerpos Anti-reaginas (V.D.R.L.)	Solicitamos amablemente a la convocante que para esta prueba se sirva aceptar V.D.R.L. ó RPR, siendo esta última considerada como una prueba más sensible y rápida para la detección de sífilis. ¿se acepta?	Apegarse a lo especificado en la ficha técnica en lo relacionado a pruebas especiales
27	FICHAS TÉCNICAS. Hormonas y Marcadores Renglón 67. H.G.C. Prueba de embarazo sérica o en orina)	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la prueba de HGC en formato de prueba rápida por el método de inmunocromatografía. ¿se acepta?	Se acepta la propuesta
28	FICHAS TÉCNICAS. Serología Especial. Renglón 142. Antígeno Helicobacter Pylori en Heces.	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar para este renglón una prueba rápida inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa de Pylori en Heces. ¿se acepta?	Se acepta la propuesta



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81)

2033.9000@gob_Nuevo León



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

11

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
29	Ficha técnica, reactivos para laboratorio. Especificaciones estudios de microbiología. Medios de cultivo recomendados. agar columbia con 5% sangre ovina	Se observa que en los siguientes cultivos: exudado faríngeo, aspirado bronquial, secreciones bronquiales, lavado bronquial, esputo, secreciones, herida quirúrgica, biopcias o tejidos, abscesos, úlseras, urocultivos, vaginal, uretral, líquidos corporales, herida quirurjica y anaerobios, se considera dentro de la marcha bacteriológica el agar columbia con 5% de sangre ovina, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar el agar sangre 5% sb, en virtud de ser un medio equivalente y de uso general para el aislamiento y el cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes procedentes de muestras clínicas para la detección de reacciones hemolíticas. ¿se acepta? favor de pronunciarse.	Se acepta la propuesta
30	Ficha técnica, reactivos para laboratorio. Especificaciones estudios de microbiología. Medios de cultivo recomendados. agar cromogénico para aislamiento selectivo e identificación de s. aureus.	Se observa que en los siguientes cultivos: exudado faríngeo, exudado nasal, aspirado bronquial, secreciones bronquiales, lavado bronquial, esputo y secreciones, se considera dentro de la marcha bacteriológica el agar cromogénico para aislamiento selectivo e identificación de s. aureus , el cual es un medio utilizado en la industria de alimentos, se solicita amablemente a la convocante permita ofertar el agar sal y manitol en placas preparadas ya que por tratarse de un medio altamente selectivo para estafilococos y de uso en área clínica funcionará adecuadamente para la identificación de s. aureus ¿se acepta? favor de pronunciarse.	Se acepta la propuesta
31	Ficha técnica, reactivos para laboratorio. Especificaciones estudios de microbiología. Medios de cultivo recomendados. agar cromogénico para aislamiento selectivo e identificación de s. aureus.	se observa que en los siguientes cultivos: exudado faríngeo, exudado nasal, aspirado bronquial, secreciones bronquiales, lavado bronquial, esputo y secreciones, se considera dentro de la marcha bacteriológica el agar cromogénico para aislamiento selectivo e identificación de s. aureus , el cual es un medio no utilizado en el área clínica y se encuentra discontinuado en el mercado, por tal motivo se solicita amablemente a la convocante permita ofertar algún otro sustituto como el agar sal y manitol o agar estafilococos 110 en placas preparadas ya que por ser agares selectivos para estafilococos y utilizados en el área clínica, funcionan adecuadamente para el aislamiento e identificación de s. aureus ¿se acepta? favor de pronunciarse.	Se acepta la propuesta



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81)

2033.9000@gob_Nuevo León



Handwritten signatures and marks in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller marks and arrows.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

12

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
32	Ficha técnica, reactivos para laboratorio. Especificaciones estudios de microbiología. Medios de cultivo recomendados. cultivos anaerobios. agar columbia con 5% sangre ovina anaerobio con fenil etil alcohol	se observa que la convocante solicita en los cultivos anaerobios el agar columbia con 5% sangre ovina anaerobio con fenil etil alcohol dentro de la marcha bacteriológica, el cual es un medio utilizado en la industria de alimentos y actualmente se encuentra discontinuado en el mercado, se solicita a la convocante nos permita ofertar como medio alterno el agar sangre 5%sb o agar cdc anaerobico en placas preparadas ya que en virtud de ser medios equivalentes para el cultivo y aislamiento de organismos fastidiosos de lento crecimiento, anaerobios obligados, y de uso en el área clínica, funcionan adecuadamente para este tipo de cultivos. ¿se acepta? favor de pronunciarse.	Se acepta la propuesta
33	Ficha técnica, reactivos para laboratorio. Especificaciones estudios de microbiología. medios de cultivo recomendados exudado uretral/vaginal. agar para aislamiento selectivo de enterococos resistentes a vancomicina.	Se observa que la convocante solicita el agar para aislamiento selectivo de enterococos resistentes a vancomicina , el cual es un medio utilizado en la industria de alimentos y que se encuentra discontinuado del mercado, solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar enterococose agar, caldo enterococcosel o agar enterococos para el aislamiento de enterococos ya sea en presentación de placa o tubo preparado o medios deshidratados para preparar, los cuales son sustitutos y sirven para el aislamiento de enterococos, siendo que la resistencia a vancomicina se puede medir mediante los antibiogramas que realizan los equipos de bacteriología. Favor de pronunciarse.	Se acepta la propuesta
34	Ficha técnica, reactivos para laboratorio. Especificaciones estudios de microbiología. medios de cultivo recomendados líquidos. medio de cultivo lowenstein-jensen	Se observa que la convocante solicita medio de cultivo lowenstein-jensen para los cultivos de líquidos. Solicitamos a la convocante permita ofertar tubo preparado de medio lowenstein-jensen o frasco deshidratado para preparar , toda vez que por su naturaleza no está disponible en el mercado en presentación de placas preparadas, favor de pronunciarse.	Se acepta el tubo preparado



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81)

2033.9000@gob_Nuevo León



Handwritten signatures and marks in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller marks and arrows.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

13

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
35	Ficha técnica, reactivos para laboratorio. Consideración para los estudios.	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si los estudios solicitados para proteínas séricas, electrolitos, y hemoglobina glucosilada, podrán ser procesados en el analizador de química clínica ofertado, toda vez que en este apartado hacen mención al siguiente punto: “procesar los estudios en cualquiera de los equipos que oferte” , además que el considerar un solo equipo para el análisis de los estudios mencionados, generaría optimización en los tiempos de procesos del área usuaria, mayor nivel de automatización y mejora tecnológica, como actualmente lo viene trabajando el instituto, no encareciendo la propuesta económica en perjuicio del instituto. Favor de pronunciarse.	Se acepta procesar los estudios en cualquiera de los equipos que oferte.
36	Ficha técnica, reactivos para laboratorio. consideración para los estudios	En caso de ser aceptada la propuesta de procesar de manera opcional los estudios en cualquiera de los equipos que se oferten. Solicitamos que solo se deba incluir la referencia del equipo de química clínica y una carta compromiso de que se procesaran el menú de pruebas de los grupos de química clínica, electrolitos, hemoglobina glucosilada y proteínas séricas. favor de pronunciarse	Favor de apegarse a ficha técnica en relación a la consideración para los estudios
37	Ficha técnica, reactivos para laboratorio. Especificaciones técnicas del equipamiento. equipo de electrolitos numeral 4	En caso de no ser aceptada nuestra propuesta. Solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar de manera opcional un analizador de electrolitos con capacidad de procesamiento de 80 a 100 muestras por hora toda vez que la convocante solicita una capacidad de procesamiento de muestras: mínimo 1000 estudios/ hora , misma que corresponde a velocidad de proceso de un analizador de química clínica automatizado. Favor de pronunciarse.	Favor de apegarse a las especificaciones técnicas del equipamiento de electrolitos numeral 4
38	Ficha técnica, reactivos para laboratorio. Consideración para los estudios. requerimiento de estudios de laboratorio para la licitación 2024	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que para las pruebas de química clínica de baja productividad como: ácido valproico, capacidad de fijación de hierro, ferritina, folatos, hierro, litio, y transferrina podrán ser procesadas de manera opcional en un laboratorio de referencia certificado tal como lo solicitan en el punto: “en caso de requerirse, enviar las muestras a procesar en el laboratorio alterno conforme a los estudios descritos en la ficha técnica y en cada uno de los grupos” . Mencionado en las consideraciones para los estudios del anexo técnico. Lo cual permitirá	Todo estudio en cuanto a su procesamiento deberá apegarse a las condiciones y especificaciones descritas en la ficha técnica.



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81)

2033.9000@gob_Nuevo León



Handwritten signatures and initials in blue ink.

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

14

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
		una mejora en la propuesta económica para el instituto. favor de pronunciarse	
39	Ficha técnica, reactivos para laboratorio. Consideración para los estudios. requerimiento de estudios de laboratorio para la licitación 2024	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que para las pruebas de proteínas séricas de baja productividad como: c3, c4, iga, igg, igm, ige y antiestreptolisinas podrán ser procesadas de manera opcional en un laboratorio de referencia certificado tal como lo solicitan en el punto: “en caso de requerirse, enviar las muestras a procesar en el laboratorio alterno conforme a los estudios descritos en la ficha técnica y en cada uno de los grupos” . Mencionado en las consideraciones para los estudios del anexo técnico lo cual permitirá una mejora en la propuesta económica para el instituto. favor de pronunciarse	Todo estudio en cuanto a su procesamiento deberá apegarse a las condiciones y especificaciones descritas en la ficha técnica.
40	Ficha técnica SISTEMA DE INFORMACIÓN	Al no contar con características técnicas en el anexo técnico, se solicita amablemente a la convocante para el cumplimiento de la solicitud de un Sistema información, se entregue una carta bajo protesta de decir verdad, que se entregara, instalara y pondremos a punto al inicio de la prestación del servicio conforme a la Especificación Técnica vigente, y se entregara folleto con las características del mismo. ¿Se acepta?	Favor de apegarse a las condiciones y especificaciones descritas en la ficha técnica en relación al sistema de información.

COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.

A. PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
1	III.2 Medio y carácter de la licitación	Se menciona que la presente licitación es de carácter Nacional Presencial, en la que solamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y los productos y/o servicios a adquirir sean producidos en el país y que cuenten con por lo menos, con un cincuenta por ciento de contenido nacional. A este respecto, Los Reactivos solicitados para Equipo en Comodato, tales como “Ácido Úrico”, “Albumina”, “Amilasa” etc. y los equipos en comodato que se mencionan en la ficha técnica para los mismos, no son producidos en México y por lo tanto no cumplen con el requisito de contar con por lo menos el cincuenta por ciento de contenido	Es posible ofertar siempre y cuando presente los permisos de importación.



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81)

2033.9000@gob_Nuevo León



Handwritten signatures and marks in blue ink are present at the bottom of the page.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

15

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
		nacional, por lo que solicitamos a la convocante nos aclare si ¿Será posible ofertar bienes que provienen de países con los que México ha establecido tratados comerciales?	
2	8.2 Documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, 8.2.8.	Se solicita escrito bajo protesta de decir verdad que somos de nacionalidad mexicana y, en el caso de adquisición de bienes, además manifestará que los bienes que oferta y entregará, serán producidos en México y contarán con el porcentaje de contenido nacional correspondiente, de acuerdo al formato Anexo 9. A este respecto, los bienes que se solicitan en esta licitación no cumplen con el grado de integración nacional solicitado, por lo que solicitamos a la convocante nos permita presentar el Anexo 9, solamente manifestando que somos de nacionalidad mexicana. ¿Se acepta esta propuesta?	Se acepta, además, deberán presentarse los permisos de importación
3	8.2 Documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, 8.2.23.	Se solicita Copia Simple de los Registros Sanitarios de los Equipos Analizadores, pero no se solicita Copia Simple de Registro Sanitario de los Reactivos. ¿Es correcto que solamente se entregará copia simple del Registro Sanitario de los Equipos? Favor de aclarar.	Se requiere copia simple del registro sanitario de equipos analizadores y reactivos
4	8.2 Documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, 8.2.16.	Se solicita Curriculum actualizado del licitante. a) Una relación de las principales operaciones de venta o prestación de servicios de los últimos doce meses, que incluya un informe técnico de los mismos, adjuntando las constancias de cumplimiento expedidas por los clientes del licitante. A este respecto, ¿Sería suficiente con enlistar solamente a cinco de nuestros clientes principales, y mencionar el importe del (los) contratos que se tengan con ellos? Favor de aclarar.	Favor de apegarse a lo señalado en el numeral 8.2.16 de la convocatoria
5	8.2 Documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, 8.2.16.	Se solicita Curriculum actualizado del licitante. a) Una relación de las principales operaciones de venta o prestación de servicios de los últimos doce meses, que incluya un informe técnico de los mismos, adjuntando las constancias de cumplimiento expedidas por los clientes del licitante. Referente al informe técnico que se solicita, ¿Sería suficiente con describir el objeto del (los) contratos que se tengan con nuestros clientes? Favor de aclarar.	Favor de apegarse a lo señalado en el numeral 8.2.16 de la convocatoria
6	8.2 Documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, 8.2.16.	Se solicita Curriculum actualizado del licitante. c) La indicación de los títulos de estudios y profesionales de los responsables de la producción de los bienes o de la prestación de servicios. A este respecto, ¿Sería suficiente con proporcionar copia del título profesional del personal de Soporte Técnico encargado de darle servicio a los equipos en comodato? Favor de aclarar.	Favor de apegarse a lo señalado en el numeral 8.2.16 de la convocatoria



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81)

2033.9000@gob_Nuevo León



Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

16

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
7	8.2 Documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, 8.2.25.	Se solicita Anexos Técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante para comprobar las especificaciones técnicas requeridas. A este respecto, ¿Sería suficiente con proporcionar solamente las hojas de manual en dónde se hace referencia a la especificación requerida? Lo anterior debido a que algunos manuales cuentan con 500-1000 hojas, todas las cuáles no son necesarias para comprobar las especificaciones. Favor de aclarar.	NO se acepta debe presentar en forma específica lo solicitado en la ficha técnica
8	8.2 Documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, 8.2.25.	En dado caso de que la respuesta a la solicitud anterior sea negativa, Solicitamos atentamente a la convocante nos permita entregar los manuales de los equipos en medio electrónico (CD o USB) para cumplir con este requisito. ¿Se acepta esta propuesta?	Se acepta la propuesta
9	8.2 Documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, 8.2.28.	Se solicita Copias simples de constancias o certificados por parte del fabricante de los equipos expedidos a nombre del personal de soporte técnico, para acreditar el dominio de herramientas relacionadas con el servicio... Así mismo, incluir una copia simple del documento de movimientos afiliatorios que demuestre que forma parte de la planilla de personal del licitante. A este respecto, si bien mi representada cuenta con Ingenieros de Soporte debidamente capacitados por el fabricante, para proporcionar un servicio más eficiente, personal del fabricante puede apoyar para dar soporte y mantenimiento a sus equipos. En tal caso, solicitamos a la convocante nos permita incluir además, las constancias del personal de Ingeniería del Fabricante que pudiera prestar el servicio en caso de ser necesario. ¿Se acepta esta propuesta?	Se acepta la propuesta

B. PREGUNTAS TÉCNICAS

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
1	Ficha Técnica, Reactivos para Laboratorios y Equipos en Comodato 2024. Consideraciones para los Estudios.	Se describe que las muestras se podrán enviar a procesar en laboratorios alternos o de referencia. ¿Cuál será el criterio para considerar las pruebas que se deben de subrogar a estos laboratorios?	Queda bajo la solicitud y autorización del químico jefe de laboratorio de ISSSTELEON.



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81)

2033.9000@gob_Nuevo León



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

17

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
2	Ficha Técnica, Reactivos para Laboratorios y Equipos en Comodato 2024. Consideraciones para los Estudios.	Se describe que las muestras se podrán enviar a procesar en laboratorios alternos o de referencia. En el caso de estudios que se pueden realizar en alguno de los equipos analizadores propuestos pero se solicitan en muy baja cantidad (menos de 50 pruebas mensuales) ¿Se nos permitirá enviar esos estudios a un laboratorio alternativo o de referencia?	Apegarse a las especificaciones de la ficha técnica en lo relativo a las condiciones de procesamiento de los estudios.
3	Ficha Técnica, Reactivos para Laboratorios y Equipos en Comodato 2024. Especificaciones Técnicas del Equipamiento. Equipo Electrolitos	Se solicita a la convocante nos permita que en el equipo de Química Clínica se puedan realizar simultáneamente las pruebas de electrolitos sin demeritar la calidad de los resultados, ¿se acepta?	Se acepta. Se acepta procesar los estudios en forma simultánea.
4	Ficha Técnica, Reactivos para Laboratorios y Equipos en Comodato 2024. Especificaciones Técnicas del Equipamiento. EQUIPO HEMATOLOGÍA	Se solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo con las siguientes características: 1. Equipo automatizado de alto rendimiento que reporte los parámetros siguientes: a) Leucocitos (WBC) b) Eritrocitos (RBC) c) Hemoglobina (HGB) d) Hematocrito (HCT) e) Volumen Corpuscular Medio (VCM) f) Hemoglobina Corpuscular Media (HCM) g) Concentración Media de Hemoglobina Corpuscular (CHCM) h) Ancho de distribución de Eritrocitos (RDW) i) Plaquetas (PLT) j) Volumen Plaquetario Medio (MPV) k) Plaquetocrito (PCT) l) Ancho de distribución de plaquetas (PDW) m) Recuento de leucocitos y diferencial de 5 poblaciones en porcentaje y valor absoluto n) Linfocitos en porcentaje y número absoluto	Se acepta su propuesta.



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81)

2033.9000@gob_Nuevo León



Handwritten signatures and marks in blue ink.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
		<ul style="list-style-type: none"> o) Mononucleares en porcentaje y número absoluto (mo) p) Eosinófilos en porcentaje y número absoluto (eo) q) Neutrófilos en porcentaje y número absoluto (ne) r) Basófilos en porcentaje y número absoluto (ba) s) Histogramas de wbc, rbc y plt. 2. Capacidad de procesamiento de 84 muestras por hora. 3. Conteo por impedancia y conteo óptico además de tecnología MAPSS. 4. Que tenga sistema abierto y cerrado 5. Volumen de muestra en modo abierto igual o menor a 150 uL 6. Autocargador y perforador de tubo con capacidad mínima de 50 tubos 7. Con cuenta Diferencial de 5 poblaciones 8. Rangos de pacientes con señalamientos alto/bajo para identificar resultados fuera de rango 9. Rangos de pacientes por edad y sexo 10. Almacenamiento de 10,000 resultados de pacientes 11. Limpieza automática de la punta de aspiración que evita el contacto con la muestra 12. Calibración y reproducibilidad del instrumento totalmente automatizado 13. Impresión de resultado automático o manual 14. Identificación alfa-numérica de pacientes 15. Control de calidad integrado y con capacidad de almacenaje de archivos de graficas de Levey-Jennings 16. Con pantalla a color para visualización de resultados y gráficas 17. Con lector de código de barras 18. Con alarma de problemas potenciales <p>¿Se acepta?</p>	



Handwritten signatures and marks in blue ink.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

19

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
5	Ficha Técnica, Reactivos para Laboratorios y Equipos en Comodato 2024. Especificaciones Técnicas del Equipamiento. EQUIPO MICROBIOLOGÍA PARA DETECCIÓN DE CRECIMIENTO MICROBIANO (HEMOCULTIVO)	Se enlistan las características del instrumento solicitado para los hemocultivos pero ese estudio (HEMOCULTIVO) no aparece en el listado de estudios. Si se va a considerar ese estudio, favor de aclarar ¿cuál sería el número de pruebas a realizar?	No se incluyó este estudio en anexo técnico de la presente licitación.
6	Ficha Técnica, Reactivos para Laboratorios y Equipos en Comodato 2024. Especificaciones Técnicas del Equipamiento. Equipo Hormonas y Marcadores Tumorales	Se solicita a la convocante nos permita que las pruebas correspondientes a Hormonas y Marcadores Tumorales se puedan realizar en un solo equipo que integre las pruebas de Química Clínica, Hormonas y Marcadores Tumorales y las de Serología y Serología Especial sin demeritar la calidad de los resultados, ¿se acepta?	No se acepta. Se solicita apegarse a las especificaciones técnicas del equipamiento para hormonas y marcadores tumorales.
7	Ficha Técnica, Reactivos para Laboratorios y Equipos en Comodato 2024. Especificaciones Técnicas del Equipamiento. Equipo Serología y Serología Especial	Se solicita a la convocante nos permita que las pruebas correspondientes a Serología y Serología Especial se puedan realizar en un solo equipo que integre las pruebas de Química Clínica, Hormonas y Marcadores Tumorales y las de Serología y Serología Especial sin demeritar la calidad de los resultados, ¿se acepta?	No se acepta. Se solicita apegarse a las especificaciones técnicas del equipamiento para serología y serología especial.
8	Ficha Técnica, Reactivos para Laboratorios y Equipos en Comodato 2024. Especificaciones Técnicas del	Se solicita a la convocante nos permita que en el equipo de Química Clínica se puedan realizar simultáneamente las pruebas de Hemoglobina Glicosilada sin demeritar la calidad de los resultados, ¿se acepta?	Se acepta su propuesta



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81)

2033.9000@gob_Nuevo León



Handwritten signatures and initials in blue ink.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

20

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
	Equipamiento. Equipo Hemoglobina Glicosilada		
9	Ficha Técnica, Reactivos para Laboratorios y Equipos en Comodato 2024. Especificaciones Técnicas del Equipamiento. EQUIPO MICROSCOPIO DE CAMPO CLARO	Se enlistan las características del Equipo Microscopio de Campo Claro ¿cuál será el número de microscopios que se deben de instalar?	Un equipo de microscopio de campo claro
10	Ficha Técnica, Reactivos para Laboratorios y Equipos en Comodato 2024. Especificaciones Técnicas del Equipamiento. EQUIPO CENTRÍFUGA	Se enlistan las características del Equipo Centrífuga ¿cuál será el número de centrifugas que se deben de instalar?	Se requiere un equipo centrífuga
11	Ficha Técnica, Reactivos para Laboratorios y Equipos en Comodato 2024. Generalidades del Servicio.	¿Se deberá proporcionar el material para la fase preanalítica (Tubos, agujas, jeringas, recipientes para las muestras, etc)? Favor de aclarar	No están incluidos en la ficha técnica de la presente licitación.
12	Ficha Técnica, Reactivos para Laboratorios y Equipos en Comodato 2024. Equipo Uroanálisis.	En el número 4 dice, velocidad de tiempo de lectura máximo de 12-18 segundos. A este respecto, el fabricante del equipo no indica la velocidad del tiempo de lectura de las tiras, sino que indica la capacidad de procesamiento la cuál es mayor a 270 pruebas por hora, lo que representaría un tiempo de lectura menor a 15 seg. Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar un equipo con estas características, especificando la capacidad de procesamiento en lugar del tiempo de lectura. ¿Se acepta esta propuesta?	Se acepta la propuesta



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81)

2033.9000@gob_Nuevo León



Handwritten signatures and initials in blue ink.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

21

IGSA MEDICAL SERVICES, S.A. DE C.V.

A. PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
1	8.2.11 Comprobante de domicilio fiscal.	Solicitamos a la Convocante que nos confirme que cumplimos con este requisito presentando recibo de telefonía a nombre del licitante y fotos del domicilio fiscal.	Se confirma
2	8.2.13 Acreditación de la capacidad económica	Solicitamos a la Convocante nos corrobore que los Estados financieros dictaminados por un contador público registrado y autorizado por la SHCP anexando copia del registro y copia simple de identificación oficial son requisito únicamente para los licitantes que no están obligados a presentar declaración anual 2022 por ser empresa de reciente creación.	Es correcta su apreciación
3	8.2.18 Escrito bajo protesta de decir verdad de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales tanto federales como estatales y municipales	Solicitamos a la Convocante que, a fin de cumplir con este requisito, nos permitan presentar Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales Federales y carta bajo protesta de decir verdad que nuestra representada no está obligada a presentar opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales vigente (noviembre 2023) emitida por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado), toda vez que su domicilio fiscal no se encuentra en el Estado de Nuevo León. ¿Se acepta?	No se acepta su propuesta
4	8.2.24 Original o copia certificada y copia simple del Aviso de Funcionamiento y responsable sanitario a nombre del licitante, para el correcto almacenamiento y distribución oportuna y la cadena de frío de los reactivos, controles, calibradores e insumos, así como comprobante de	Debido a que nuestra empresa tiene celebrado un contrato de Almacenaje y Logística de Cadena de frío, solicitamos a la convocante que a fin de cumplir con este requisito, nos permita presentar comprobante de domicilio a nombre de la empresa contratada, así como aviso de funcionamiento a nombre del licitante. ¿Se acepta?	Favor de apegarse a lo solicitado en la ficha técnica numeral 8.2.24



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81)

2033.9000@gob_Nuevo León



[Handwritten signatures and marks in blue ink]

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

22

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
	domicilio del establecimiento a nombre del licitante		
5	8.2.29 Todos los requisitos adicionales y/o documentación solicitada en la Ficha Técnica	A fin de cumplir con este requisito, solicitamos a la Convocante nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicada, mi representada se compromete a cumplir en tiempo y forma con los requisitos y documentos entregables solicitados en la Ficha Técnica, toda vez que éstos son obligatorios únicamente para el licitante adjudicado. ¿Se acepta?	No se acepta su propuesta, apegarse a lo solicitado en la ficha técnica.

B. PREGUNTAS TÉCNICAS

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
1	Punto 8.2.28 Copias simples de constancias o certificados por parte del fabricante de los equipos expedidos a nombre del personal de soporte técnico	Se solicita amablemente a la convocante que con la finalidad de cumplir con este punto nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad de que el personal que proporcionara el soporte técnico cuenta con dominio de herramientas relacionadas con el servicio y está capacitado en la ejecución de los Mantenimientos Preventivos y Correctivos de los equipos propuestos ¿Se acepta?	Favor de apegarse a lo solicitado en la ficha técnica numeral 8.2.28
2	Punto 8.2.28 Copias simples de constancias o certificados por parte del fabricante de los equipos expedidos a nombre del personal de soporte técnico	En caso de ser negativa la respuesta a la pregunta anterior, Se solicita amablemente a la convocante que con la finalidad de cumplir con este punto nos permita presentar Copias simples de constancias o certificados por parte del fabricante de los equipos expedidos a nombre del personal de soporte técnico y carta bajo protesta de decir verdad del fabricante de los equipos donde indique que el personal pertenece a su plantilla. ¿Se acepta?	Favor de apegarse a lo solicitado en la ficha técnica numeral 8.2.28
3	Punto 3 de la "Ficha Técnica"	En el punto 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO, EQUIPO HEMOGLOBINA GLUCOSILADA dice: "...3 Capacidad de procesamiento de muestras por hora: Mínimo 100 estudios/hora..." Se entiende que al no existir algún equipo que haga de manera exclusiva la determinación de hemoglobina glicosilada y tenga una productividad de 100 pruebas /hora o superior, estas se podrán procesar y ser referenciado en un equipo de química sanguínea con dicha capacidad de procesamiento. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta la apreciación, podrá referenciar al equipo de química clínica con la misma capacidad de procesamiento



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81)

2033.9000@gob_Nuevo León



Handwritten signatures and arrows pointing to the right.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

23

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
4	Punto 3 de la "Ficha Técnica"	En el punto 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO, EQUIPO ELECTROLITOS dice: "...4 Capacidad de procesamiento de muestras por hora: Mínimo 1000 estudios/hora..." Se entiende que al no existir algún equipo que haga de manera exclusiva la determinación de electrolitos y tenga una productividad de 1000 pruebas /hora o superior, estas se podrán procesar y ser referenciado en un equipo de química sanguínea con dicha capacidad de procesamiento. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta la apreciación, podrá referenciar al equipo de química clínica con la misma capacidad de procesamiento
5	8.2.24 Original o copia certificada y copia simple del Aviso de Funcionamiento y responsable sanitario a nombre del licitante, para el correcto almacenamiento y distribución oportuna y la cadena de frío de los reactivos, controles, calibradores e insumos, así como comprobante de domicilio del establecimiento a nombre del licitante	Debido a que nuestra empresa tiene celebrado un contrato de Almacenaje y Logística de Cadena de frío, solicitamos a la convocante que a fin de cumplir con este requisito, nos permita presentar comprobante de domicilio a nombre de la empresa contratada, así como aviso de funcionamiento a nombre del licitante. ¿Se acepta?	Favor de apegarse a lo solicitado en la ficha técnica numeral 8.2.24

Se informa que las solicitudes de aclaración fueron solventadas por la Directora de Servicios Médicos del ISSSTELEON, la Doctora Ma. Guadalupe Garza Sagástegui, cuya firma aparece al final de la presente acta, así como con el apoyo del personal a su cargo del ISSSTELEON y el personal del área jurídica del ISSSTELEON.

En este acto se hace entrega de la versión electrónica de las solicitudes de aclaración mediante medio físico a las personas que así lo entregaron, de conformidad con el artículo 72 párrafo nueve del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81)

2033.9000@gob_Nuevo León



[Firmas manuscritas]

[Firma manuscrita]

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO

24

TERCERO.- CIERRE DEL ACTA: De conformidad con el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, esta acta forma parte integrante de la convocatoria y deberá de ser considerada por los licitantes en la elaboración de sus propuestas.

Asimismo, para efectos de la notificación y en términos del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, en la página WEB del ISSSTELEON <http://www.isssteleon.gob.mx>, la presente acta.


A su vez, se recuerda a los licitantes que el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas se llevará a cabo el día **once de diciembre del año dos mil veintitrés** a las **quince horas con treinta minutos** en este mismo lugar.

No existiendo aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada esta junta, siendo las **once horas con treinta y siete minutos** del día al inicio señalado, levantándose el acta correspondiente, firmando la misma para constancia y efectos legales que le son inherentes, las personas que intervinieron en este acto y así quisieron hacerlo, sirviendo la presente acta de notificación legal, entregándose copia de la misma a cada uno de los presentes.

Miembros del Comité de Adquisiciones del ISSSTELEON
Con voz y voto:

Lic. Juan Enrique Villarreal Salazar
Director de Administración del ISSSTELEON
En representación del Lic. Luis Gerardo Gómez Guzmán,
Director General del ISSSTELEON

Lic. Juan Silvano Hernández Sena
En representación de la Secretaría de Administración del
Estado de Nuevo León

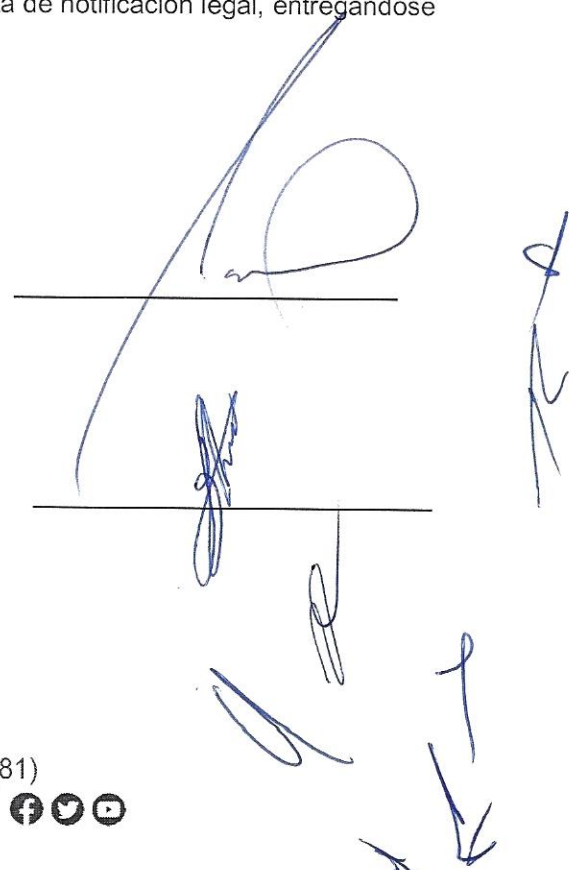

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

25

Lic. Guillermo Zamora Garza


Subdirector Jurídico Consultivo y suplente del representante del área jurídica del ISSSTELEON



Sólo con voz:

Lic. Yadira Faz Cedillo


Representante de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León

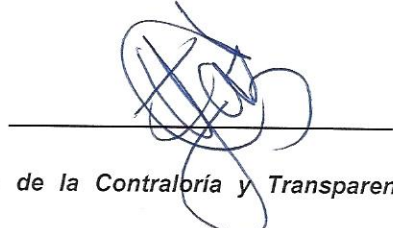

“Dejando salvaguardadas las facultades de verificación y comprobación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental”

Dra. Ma. Guadalupe Garza Sagástegui

*Directora de Servicios Médicos del ISSSTELEON
Representante del área que requirió el bien y/o servicio*

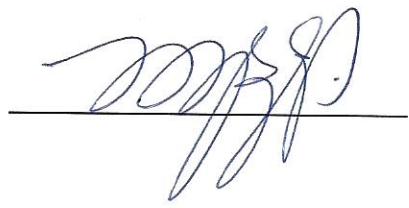

Testigo Social


C. Ruth Magdalena González Góngora



Por los licitantes

BIODIST, S.A. DE C.V.

C. José Alfredo Soto Alonso

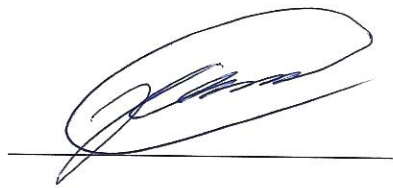

**COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS
Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.**

C. René Gerardo Salazar Robledo



IGSA MEDICAL SERVICES, S.A. DE C.V.



C. Ricardo Ernesto Moreno Rodríguez



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO

Monterrey, Nuevo León a 01 de diciembre de 2023.


1	
NOMBRE DEL LICITANTE:	<u>Comercializadora de Reactivos para Laboratorios y</u>
REPRESENTANTE LEGAL:	<u>Material para Hospitales, S.A. de C.V.</u> <u>Rene Gerardo Salazar Roldo</u>
NOMBRE DE LA PERSONA QUE SE PRESENTA A LA JUNTA DE ACLARACIONES:	<u>Rene Gerardo Salazar Roldo</u>
FIRMA:	
CORREO ELECTRÓNICO:	<u>rsalazar@crimh.com</u>
2	
NOMBRE DEL LICITANTE:	<u>IGSA Medical Services SA de CV</u>
REPRESENTANTE LEGAL:	<u>Homero Oliver Sanchez Peña</u>
NOMBRE DE LA PERSONA QUE SE PRESENTA A LA JUNTA DE ACLARACIONES:	<u>Ricardo Ernesto Moreno Rodriguez</u>
FIRMA:	
CORREO ELECTRÓNICO:	<u>rmoreno@igsamedical.com</u>



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

Monterrey, Nuevo León a 01 de diciembre de 2023.

3	
NOMBRE DEL LICITANTE:	<u>Biodist SA de CV</u>
REPRESENTANTE LEGAL:	<u>Miguel Angel Aronow</u>
NOMBRE DE LA PERSONA QUE SE PRESENTA A LA JUNTA DE ACLARACIONES:	<u>José Alfredo Soto Alonso</u>
FIRMA:	
CORREO ELECTRÓNICO:	<u>alfredo.soto@biodist.com</u>
4	
NOMBRE DEL LICITANTE:	_____
REPRESENTANTE LEGAL:	_____
NOMBRE DE LA PERSONA QUE SE PRESENTA A LA JUNTA DE ACLARACIONES:	_____
FIRMA:	_____
CORREO ELECTRÓNICO:	_____



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-010/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPO EN COMODATO**


Monterrey, Nuevo León a 01 de diciembre de 2023

Miembros del Comité de Adquisiciones del ISSSTELEON

Con voz y voto:


Lic. Juan Enrique Villarreal Salazar

*Director de Administración del ISSSTELEON
En representación del Lic. Luis Gerardo Gómez Guzmán,
Director General del ISSSTELEON*

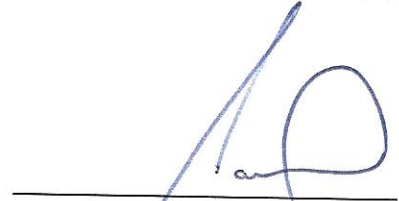

Lic. Juan Silvano Hernández Sena

*En representación de la Secretaría de Administración del
Estado de Nuevo León*



Lic. Guillermo Zamora Garza


*Subdirector Jurídico Consultivo y suplente del
representante del área jurídica del ISSSTELEON*



Sólo con voz:

Lic. Yadira Faz Cedillo

*Representante de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León*



Dra. Ma. Guadalupe Garza Sagástegui

*Directora de Servicios Médicos del ISSSTELEON
Representante del área que requirió el bien y/o servicio*



Testigo Social

C. Ruth Magdalena González Góngora

