

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN****ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-001/2024
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO MÉDICO TORRE DE ENDOSCOPIA COMPLETA**

1


En la ciudad de Monterrey, Nuevo León siendo las **10:09-diez horas con nueve minutos** del día **trece de junio del año dos mil veinticuatro**, en la Sala de Consejo del Instituto, ubicada en la calle Mariano Matamoros 319 poniente en el Centro de esta Ciudad; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria del procedimiento de licitación arriba mencionado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, 72 y 73 de su Reglamento, así como del numeral 6 de la convocatoria de licitación.

Presidiendo este acto el **Lic. Juan Enrique Villarreal Salazar**, Director de Administración del ISSSTELEON, servidor público designado por el **Lic. Luis Gerardo Gómez Guzmán**, Director General del ISSSTELEON, a través del memorándum número **DG-040/2024** de fecha **cuatro de junio del año dos mil veinticuatro**, quien procede a dar continuación a la sesión de junta de aclaraciones; asimismo, se hace constar que se cuenta con la presencia del Testigo Social asignado y acreditado por la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la Ciudadana **Surisadday Campos Hernández**.

PRIMERO.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM: Vista la lista de asistencia de la presente sesión se verifica y da fe por parte del Encargado de la Dirección Jurídica y representante del área jurídica del ISSSTELEON, el **Lic. Guillermo Zamora Garza**, que de conformidad con el artículo 18, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, se encuentra presente la totalidad de los integrantes del Comité de Adquisiciones con derecho a voz y voto, así como los invitados a esta junta de aclaraciones, por lo que los acuerdos tomados en la presente sesión son válidos y subsistentes para todos los efectos legales.

TERCERO.- ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES: El Presidente del acto, hace constar que de conformidad al artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y el numeral 6 de la convocatoria, se recibieron en tiempo y forma las solicitudes de aclaración, así como el escrito de interés en participar de las siguientes personas:

No.	Nombre (Razón o Denominación Social)	Número de solicitudes de aclaración
1	MEDICAZEN, S.A. DE C.V.	5
2	DISPOSITIVOS MÉDICOS DEL NORTE, S. DE R.L.	16

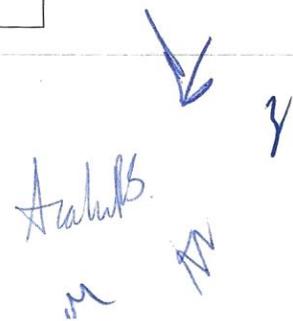

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-001/2024
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO MÉDICO TORRE DE ENDOSCOPIA COMPLETA**

2


No.	Nombre (Razón o Denominación Social)	Número de solicitudes de aclaración
3	STRYKER MÉXICO, S.A. DE C.V.	19
4	INGENIERÍA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD, S.A. DE C.V.	16
TOTAL DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN		56

Acto seguido, se procede a la lectura de las solicitudes de aclaración a la convocatoria, presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la convocante, como se indica a continuación:

MEDICAZEN, S.A. DE C.V.

B. PREGUNTAS TÉCNICAS


Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
1	Partida 1. Colonovideoendoscopio g. Diámetro del extremo distal de 13.2 mm	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un colonovideoendoscopio de alta definición con un diámetro del extremo distal de 13.2 mm en el entendido que es normal que la porción distal sea un poco mayor a la del diámetro externo (12.8 mm) ya que en ella se encuentra la porción rígida donde se encuentra el aislamiento eléctrico, lentes de las guías de iluminación y lente objetivo, aunado a que este modelo es el estándar y la diferencia de 0.4 mm no es significativa. ¿Se acepta nuestra solicitud?	SE ACEPTA
2	Partida 1. Monitor LCD 4K de ultra-alta definición d. De alta definición especificando HDMI, DVI, RGB, compuesta, VIC S-VIDEO, SDI HD.	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un Monitor LCD 4K de ultra-alta definición especificando HDMI, SDI 12-G y SDI 3-G. Las cuales son señales que se trabajan con el video procesador ofertado y dado que el equipo no maneja señales de video estándar analógicas, no requiere de las demás solicitadas. ¿Se acepta nuestra solicitud?	SE ACEPTA
3	Partida 1. Monitor LCD 4K de ultra-alta definición f. Con opción de salidas DVI, S-VIDEO, RGB Y compuesto.	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un Monitor LCD 4K de ultra-alta definición con opción de salidas HDMI, SDI 12-G y SDI 3-G. ¿Se acepta nuestra solicitud?	SE ACEPTA




isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000

@gob_Nuevo León    



Handwritten notes and signatures: "Arriba" with an arrow pointing up, and other illegible signatures.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-001/2024
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO MÉDICO TORRE DE ENDOSCOPIA COMPLETA**

3

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
4	Partida 1. Generador Electroquirúrgico para Endoscopia. h. Impresora multifuncional calidad fotográfica	Solicitamos a la convocante nos confirme si la Impresora multifuncional calidad fotográfica corresponde al Sistema de Captura de Imágenes. ¿Es correcta nuestra apreciación?	CORRECTO
5	Partida 1. Generador Electroquirúrgico para Endoscopia. h. Impresora multifuncional calidad fotográfica	Solicitamos a la convocante nos confirme si la Impresora multifuncional calidad fotográfica podría ser ofertada de marca compatible con el equipo solicitado por la convocante. ¿Se acepta nuestra solicitud?	SE ACEPTA


DISPOSITIVOS MÉDICOS DEL NORTE, S. DE R.L.

B. PREGUNTAS TÉCNICAS

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
1	FICHA TÉCNICA, PROCESADOR DE VIDEO PUNTO F.	PROTECCIÓN DE DESCARGAS ELÉCTRICAS. QUE CUMPLA CON LAS CLASIFICACIONES SEGÚN LA NORMA IEC 60364-7-710; 2002-11, CLASE I, TIPO 1, BF 0 SUPERIOR. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ES VALIDO REFERENCIAR LA NORMA IEC 60320-1, CLASE I, TIPO 1, BF. COMO OPCIÓN, ¿ES CORRECTO?	DEBERÁ APEGARSE A LA SOLICITUD, NORMA IEC 60364-7-710; 2002-11, CLASE I, TIPO 1, BF
2	FICHA TÉCNICA, PROCESADOR DE VIDEO PUNTO G	CON ZOOM DIGITAL CON AUMENTOS DE AL MENOS 1.0 X, 1.2 X Y 1.5 X PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE OFERTAR ESPECIFICACIONES SUPERIORES COMO: ZOOM DIGITAL ELECTRÓNICO DE 1.0 X A 2.0 X, CUMPLE CON LO SOLICITADO, ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SOLO SI LOS AUMENTOS SE PUEDEN EJERCER EN AUMENTOS DE 1.0, 1.2 Y 1.5 POR LO MENOS
3	FICHA TÉCNICA, FUENTE DE LUZ DE XENÓN PUNTO A.	CON LÁMPARA DE XENÓN DE 300 WATTS 0 SUPERIOR, DISERIADA PARA ENDOSCOPIA CON VIDA MEDIA DE 500 HORAS COMO MÍNIMO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE OFERTAR ESPECIFICACIONES SUPERIORES COMO: LÁMPARA DE LED DE 1400 LÚMENES, DISEÑADA PARA ENDOSCOPIA CON VIDA MEDIA DE 6 AÑOS, CUMPLE CON LO SOLICITADO, ¿ES CORRECTO?	SE SOLICITA LÁMPARA DE XENÓN DE 300 WATTS POR LO MENOS CON 500 HORAS DE USO POR LO MENOS.





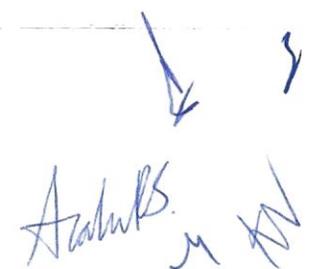

 isssteleon.gob.mx
 Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000
 @gob_Nuevo León    

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-001/2024
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO MÉDICO TORRE DE ENDOSCOPIA COMPLETA**

4

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
4	FICHA TÉCNICA, FUENTE DE LUZ DE XENÓN PUNTO H	PUERTO PARA CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA, PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL PUERTO PARA CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA, SE PUEDE REFERENCIAR CON EL PUERTO DE CONEXIÓN DEL ENDOSCOPIO A LA FUENTE DE LUZ, ¿ES CORRECTO?	CORRECTO
5	FICHA TÉCNICA, GASTROVIDEOSCOPIO PUNTO F	DIÁMETRO DEL TUBO DE INSERCIÓN DE 9.9 MM PREGUNTA ENTENDEMOS QUE OFERTAR ESPECIFICACIONES SUPERIORES COMO: DIÁMETRO DEL TUBO DE INSERCIÓN (FLEXIBLE) DE 9.3 MM, CUMPLE CON LO SOLICITADO, EN EL ENTENDIDO DE QUE UN DIÁMETRO MENOR ES UN BENEFICIO AL PACIENTE, ¿ES CORRECTO?	CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO NOS DE LA IMAGEN DESEADA
6	FICHA TÉCNICA, GASTROVIDEOSCOPIO PUNTO G	DIÁMETRO DEL EXTREMO DISTAL DE 9.9 MM PREGUNTA ENTENDEMOS QUE OFERTAR ESPECIFICACIONES SUPERIORES COMO: DIÁMETRO DEL EXTREMO DISTAL DE 9.2 MM, CUMPLE CON LO SOLICITADO, EN EL ENTENDIDO DE QUE UN DIÁMETRO MENOR ES UN BENEFICIO AL PACIENTE, ¿ES CORRECTO?	CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO NOS DE LA IMAGEN DESEADA
7	FICHA TÉCNICA, COLONOVideosCOPIO PUNTO A	DIÁMETRO DEL CANAL DE TRABAJO DE 3.7 MM. COMO MÁXIMO PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE OFERTAR ESPECIFICACIONES SUPERIORES COMO: DIÁMETRO DEL CANAL DE TRABAJO DE 3.8 MM. , CUMPLE CON LO SOLICITADO, EN EL ENTENDIDO DE QUE UN DIÁMETRO MAYOR PERMITE INTRODUCIR UNA MAYOR GAMA DE INSTRUMENTAL, ¿ES CORRECTO?	LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS ACEPTADAS
8	FICHA TÉCNICA, COLONOVideosCOPIO PUNTO F	DIÁMETRO DEL TUBO DE INSERCIÓN DE 12.8 MM PREGUNTA ENTENDEMOS QUE OFERTAR ESPECIFICACIONES SUPERIORES COMO: DIÁMETRO DEL TUBO DE INSERCIÓN (FLEXIBLE) DE 12.0 MM, CUMPLE CON LO SOLICITADO, EN EL ENTENDIDO DE QUE UN DIÁMETRO MENOR ES UN BENEFICIO AL PACIENTE, ¿ES CORRECTO?	CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO NOS DE LA IMAGEN DESEADA
9	FICHA TÉCNICA, COLONOVideosCOPIO PUNTO G	DIÁMETRO DEL EXTREMO DISTAL DE 12.8 MM PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE OFERTAR ESPECIFICACIONES SUPERIORES COMO: DIÁMETRO DEL EXTREMO DISTAL DE 12.0 MM, CUMPLE CON LO SOLICITADO, EN EL ENTENDIDO DE QUE UN DIÁMETRO MENOR ES UN BENEFICIO AL PACIENTE, ¿ES CORRECTO?	CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO NOS DE LA IMAGEN DESEADA
10	FICHA TÉCNICA, MONITOR LCD 4K DE ULTRA ALTA-DEFINICIÓN PUNTO D	DE ALTA DEFINICIÓN ESPECIFICANDO HDMI, DVI, RGB, COMPUESTA, VIC S-VIDEO, SDI HD. PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PUERTOS DE ENTRADA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI, DISPLAY PORT, DVI, 3G-SDI) COMPATIBLES CON EL VIDEOPROCESADOR OFERTADO, ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ CUMPLIR CON LO SOLICITADO HDMI, DVI, RGB, COMPUESTA, VIC S-VIDEO, SDI HD



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000

@gob_Nuevo León



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-001/2024
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO MÉDICO TORRE DE ENDOSCOPIA COMPLETA**

5

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
11	FICHA TÉCNICA, MONITOR LCD 4K DE ULTRA ALTA-DEFINICIÓN PUNTO F	CON OPCIÓN DE SALIDAS DVI, S-VIDEO, RGB Y COMPUESTO. PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PUERTOS DE SALIDAS DVI, DISPLAY PORT, 3G-SDI, ¿SE ACEPTA?	SE REQUIEREN SALIDAS DVI, S-VIDEO, RGB Y COMPUESTO
12	FICHA TÉCNICA, COMPROBADOR DE IMPERMEABILIDAD	PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMPROBADOR DE IMPERMEABILIDAD DE ACUERDO AL FABRICANTE, ES DECIR, DE LA MISMA MARCA Y COMPATIBLE CON LOS ENDOSCOPIOS OFERTADOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN MODIFICAR LO SOLICITADO
13	FICHA TÉCNICA, SISTEMA DE CAPTURA DE IMÁGENES PUNTO A	EQUIPO DE COMPUTE TIPO WORKSTATION 8 GB RAM, DD 2 TB SATA, CD/DVD-RW 8X, PUERTO SERIAL DISPONIBLE, WINDOWS 7 PROFESIONAL 32 BITS, TECLADO, MOUSE, TARJETA DE RED 100/1000 MBPS, MONITOR DE 17" PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COMPUTADORA DE ACUERDO AL SOFTWARE OFERTADO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD Y NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR EQUIPO COMPATIBLE CON LOS DEMÁS EQUIPOS DE SU OFERTA
14	FICHA TÉCNICA, SISTEMA DE CAPTURA DE IMÁGENES PUNTO C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA DE 350 VA (UPS 0 NO BREAK) PREGUNTA ENTENDEMOS QUE OFERTAR UN UPS DE 1500VA O SUPERIOR CUMPLE CON LO SOLICITADO, ¿ES CORRECTO?	QUE CUMPLA COMO MÍNIMO CON LO QUE SE SOLICITA UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA DE 350 VA (UPS 0 NO BREAK)
15	FICHA TÉCNICA, SISTEMA DE CAPTURA DE IMÁGENES PUNTO D	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE SLIMED E) TARJETA DE CAPTURA PARA SLIMED HD " PREGUNTA PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SOFTWARE EN2SOFT COMPATIBLE CON LA TORRE DE ENDOSCOPIA OFERTADA, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR EL SOFTWARE COMPATIBLE CON EL EQUIPO QUE SE PROPONGAN
16	FICHA TÉCNICA, SISTEMA DE CAPTURA DE IMÁGENES PUNTO F	CABLE ELITE HDMI A DVI-D DE 1.8 M G) COMPUTADORA ENSAMBLADA SIN MONITOR " PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL HARDWARE DE ACUERDO AL SOFTWARE OFERTADO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD Y NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR EL CABLE COMPATIBLE CON EL EQUIPO QUE SE PROPONGAN



Handwritten signatures and initials:
A. A. B. B.
M
W

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-001/2024
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO MÉDICO TORRE DE ENDOSCOPIA COMPLETA**

6

STRYKER MÉXICO, S.A. DE C.V.

A. PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
1	PUNTO 2 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EN MÁXIMO 60 DÍAS, DADO QUE SE OFERTARÁN EQUIPOS DE IMPORTACIÓN Y SU PROCESO TARDA TRES SEMANAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE AL TIEMPO SOLICITADO
2	PUNTO 2 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS SEA EN DOS PARTES A TREINTA DÍAS 5 EQUIPOS Y LOS OTROS 4 A 60 DÍAS, DADO QUE SE OFERTARÁN EQUIPOS DE IMPORTACIÓN Y SU PROCESO TARDA TRES SEMANAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTAN ENTREGAS PARCIALES YA QUE LOS EQUIPOS FUNCIONAN COMO UN TODO
3	8.2.26 Carta de apoyo del fabricante en original, papel membretado y firma autógrafa, en la que manifieste reconocer al licitante como distribuidor autorizado de su marca, indicando que cuenta con la capacidad técnica suficiente para responder por las garantías de los equipos. Adicionalmente deberá de incluir copia simple del poder que acredite al firmante, así como, copia simple de su identificación oficial con fotografía vigente. La falta de estos documentos es motivo de descalificación.	En el entendido de que STRYKER MÉXICO S.A. DE C.V. es distribuidor primario y titular de los registros sanitarios de los equipos a ofertar, y además cuenta con carta apostillada de distribución exclusiva otorgada por el fabricante que le brinda facultados para distribuir y reparar a todos los equipos de la marca STRYKER en el territorio mexicano. Entendemos que la carta solicitada en este punto podrá ser emitida por dicha razón social y deberá de ser acompañada por la carta que se menciona arriba. ¿Es correcto?	ES CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO LA MARCA OFERTADA SEA LA QUE ESTIPULEN EN LA CARTA
4	8.2.27. Copia certificada del pedimento de importación de los equipos. La falta de este documento	Entendemos que este documento deberá ser presentado en la entrega de los equipos, ya que el pedimento de importación se tendrá hasta que los equipos hayan sido importados a México. Por lo anterior, podremos presentar como opción a este punto carta bajo protesta de decir verdad que la importación de los equipos será bajo el amparo de la legislación aduanera. ¿Se acepta?	LA COPIA DEL PEDIMENTO PUEDE SER SIMPLE YA QUE SE SOLICITA PARA REFERENCIAR QUE LOS EQUIPOS ENTRARON

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000

@gob_Nuevo León 



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-001/2024
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO MÉDICO TORRE DE ENDOSCOPIA COMPLETA**

7

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
	no es motivo de descalificación		AL PAÍS CON ANTERIORIDAD AL FALLO
5	8.2.30. Escrito expedido por el fabricante, con el cual se acredite que la marca cuenta con las piezas y refacciones para los mantenimientos, reparaciones y garantías correspondientes. Además de obligarse como responsable solidario del licitante en caso de vicios ocultos y fallas. La falta de este documento es motivo de Descalificación.	En el entendido de que STRYKER MÉXICO S.A. DE C.V. es distribuidor primario y titular de los registros sanitarios de los equipos a ofertar, y además cuenta con carta apostillada de distribución exclusiva otorgada por el fabricante que le brinda facultados para reparar, dar mantenimiento e importar refacciones a todos los equipos de la marca STRYKER en el territorio mexicano. Entendemos que la carta solicitada en este punto podrá ser emitida por dicha razón social y deberá de ser acompañada por la carta que se menciona arriba, documento en el que se menciona el apoyo total del fabricante en caso de vicios ocultos y fallas. ¿Es correcto?	ES CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO LA MARCA OFERTADA SEA LA QUE ESTIPULEN EN LA CARTA
6	1.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.	Con el fin de entregar equipo completo, se solicita a la convocante permita participación conjunta en el presente procedimiento, siempre y cuando ambos licitantes realicen el pago y la inscripción. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTAN PROPUESTAS CONJUNTAS
7	1.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.	Con el fin de entregar equipo completo, se solicita a la convocante permita ofertar una marca diferente de generador electro quirúrgico para endoscopia siempre y cuando cumpla con las características solicitadas en bases, lo anterior no demerita el funcionamiento del equipo. ¿Se acepta?	LAS OFERTAS SON POR PARTIDA, PODRÁ OFERTAR LO QUE CONVenga

B. PREGUNTAS TÉCNICAS

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
1	Fuente de luz de xenón	Se solicita a la convocante permita ofertar equipo que cuente con fuente de luz led con vida útil de un año. ¿Se acepta?	SE SOLICITA LUZ DE XENÓN SIN ESPECIFICAR LA DURACIÓN

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-001/2024
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO MÉDICO TORRE DE ENDOSCOPIA COMPLETA**

8

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
2	Gastroendoscopio c. Acodamiento arriba/abajo de 210°/90° como mínimo.	Se solicita a la convocante aclarar a que se refiere con acodamiento. Favor de aclarar.	SE REFIERE AL ANGULO DE FLEXIÓN DE LA PUNTA DISTAL DEL GASTROENDOSCOPIO
3	Gastroendoscopio d. Acodamiento izquierdo/derecha de 100°/100° como mínimo.	Se solicita a la convocante aclarar a que se refiere con acodamiento. Favor de aclarar.	SE REFIERE AL ANGULO DE FLEXIÓN DE LA PUNTA DISTAL DEL GASTROENDOSCOPIO
4	Gastroendoscopio h. Con tecnología que permita la alta desinfección COMÚN a los equipos de endoscopia.	Se solicita a la convocante aclarar a que se refiere con desinfección común a los equipos de endoscopia. Favor de aclarar.	SE REFIERE A LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL
5	Fuente de luz g. Con contenedor para alimentación aire y agua.	Se solicita a la convocante aclarar a que hace referencia el contenedor para alimentación aire y agua. Favor de aclarar.	SE REFIERE AL CONTENEDOR AL CUAL SE CONECTA EL ENDOSCOPIO PARA LA EMISIÓN DE AIRE Y AGUA
6	Procesador de video j. Con sistema de cromo endoscopia digital	Solicitamos a la convocante aclarar si se refiere a diferentes maneras de visualización de la fluorescencia o sólo que se pueda ver el medio de contraste de fluorescencia en la irrigación. Favor de aclarar.	NO SE ENTIENDE LA PREGUNTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO. NO TIENE RELACIÓN CON MEDIO DE CONTRASTE DE FLUORESCENCIA.
7	GENERADOR ELECTROQUIRURGICO PARA ENDOSCOPIA	Se solicita a la convocante, permita considerar este punto como opcional o permita ofertar el mango y el inserto. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA. DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA.
8	Gastrovideoendoscopio. Colonovideoendoscopio	Se solicita a la convocante, permita considerar este punto como opcional. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA. DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA.
9	Monitor LCD 4K de ultra alta definición	Se solicita a la convocante permita ofertar monitor OLED 4K de ultra alta definición. ¿Se acepta?	SE ACEPTA





isssteleon.gob.mx
Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000
@gob_Nuevo León





**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-001/2024
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO MÉDICO TORRE DE ENDOSCOPIA COMPLETA**

9

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
10	Mueble rodante en configuración estándar. g. Con colgador para dos endoscopios incorporado.	Se solicita a la convocante, permita considerar este punto como opcional. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA. DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA.
11	Comprobador de impermeabilidad	Se solicita a la convocante aclare a que se refiere con comprobador de impermeabilidad. Favor de aclarar.	SE REFIERE AL PROBADOR DE FUGAS
12	Sistema de captura de imágenes	Se solicita a la convocante permita ofertar como opción a este punto consola con funcionalidad de documentación digital para capturar, transferir y almacenar y mostrar electrónicamente información médica. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA. DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA.

INGENIERÍA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD, S.A. DE C.V.

B. PREGUNTAS TÉCNICAS

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
1	Ficha técnica Procesador de Video Inciso F	La Convocante solicita "Protección d descargas eléctricas, que cumpla con las clasificaciones según la NORMA IEC 60364-7-7 10;2002-11, CLASEI, TIPO 1, BF o superior" Entendemos que es válido para dar cumplimiento a este punto presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que se manifieste el cumplimiento a la NORMA IEC 60364-7-7 10;2002- 11, CLASEI, TIPO 1, BF ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTO
2	Ficha técnica Procesador de Video Inciso G	La Convocante solicita "Con lámpara de Xenón de 300 watts 0 o superior, diseriada para endoscopia con vida media de 500 horas como mínimo. Entendemos que ofertar especificaciones superiores como: zoom digital electrónico de 1.0 x a 2.0 x, cumple con lo solicitado ¿Es correcta nuestra apreciación?	NO SE ENTIENDE LA PREGUNTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO, SE HABLA DE DOS CONCEPTOS DIFERENTES
3	Ficha técnica Fuente de luz de Xenón Inciso A	La Convocante solicita "Con lámpara de xenón de 300 watts 0 superior, diseriada para endoscopia con vida media de 500 horas como mínimo" Entendemos que ofertar especificaciones superiores como: lámpara de LED de 1400 Lúmenes, diseñada para endoscopia con vida media de 6 años, cumple con lo solicitado ¿Es correcta nuestra apreciación?	SE SOLICITA LÁMPARA DE XENÓN DE 300 WATTS POR LO MENOS CON 500 HORAS DE USO POR LO MENOS.



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000

@gob_Nuevo León 

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-001/2024
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO MÉDICO TORRE DE ENDOSCOPIA COMPLETA**

10

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
4	Ficha técnica Fuente de luz de Xenón Inciso H	La Convocante solicita "Puerto para conexión de fibra óptica" Entendemos que el Puerto para conexión de fibra óptica, se puede referenciar con el puerto de conexión del endoscopio a la fuente de luz ¿Es correcta nuestra apreciación?	CORRECTO
5	Ficha técnica Gastrovideoscopio Inciso F	La convocante solicita "Diámetro del tubo de inserción de 9.9 mm" Entendemos que ofertar especificaciones superiores como: Diámetro del tubo de inserción (flexible) de 9.3 mm, cumple con lo solicitado, en el entendido de que un diámetro menor es un beneficio al paciente ¿Es correcta nuestra apreciación?	CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO NOS DE LA IMAGEN DESEADA
6	Ficha técnica Gastrovideoscopio Inciso G	La Convocante solicita "Diámetro del extreme distal de 9.9 mm" Entendemos que ofertar especificaciones superiores como: Diámetro del extremo distal de 9.2 mm, cumple con lo solicitado, en el entendido de que un diámetro menor es un beneficio al paciente ¿Es correcta nuestra apreciación?	CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO NOS DE LA IMAGEN DESEADA
7	Ficha técnica Colonovideoscopio Inciso A	La Convocante solicita "Diámetro del canal de trabajo de 3.7 mm. Como máximo" Entendemos que ofertar especificaciones superiores como: Diámetro del canal de trabajo de 3.8 mm., cumple con lo solicitado, en el entendido de que un diámetro mayor permite introducir una mayor gama de instrumental ¿Es correcta nuestra apreciación?	LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS ACEPTADAS
8	Ficha técnica Colonovideoscopio Inciso F	La Convocante solicita "Diámetro del tubo de inserción de 12.8 mm" Entendemos que ofertar especificaciones superiores como: Diámetro del tubo de inserción (flexible) de 12.0 mm, cumple con lo solicitado, en el entendido de que un diámetro menor es un beneficio al paciente ¿Es correcta nuestra apreciación?	CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO NOS DE LA IMAGEN DESEADA
9	Ficha técnica Colonovideoscopio Inciso G	La Convocante solicita "Diámetro del extremo distal de 12.8 mm" apreciación" Entendemos que ofertar especificaciones superiores como: Diámetro del extremo distal de 12.0 mm, cumple con lo solicitado, en el entendido de que un diámetro menor es un beneficio al paciente ¿Es correcta nuestra apreciación?	CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO NOS DE LA IMAGEN DESEADA
10	Ficha Técnica Monitor LCD 4K de Ultra Alta – Definición Inciso D	La Convocante solicita "De alta definición especificando HDMI, DVI, RGB, compuesta, VIC S-VIDEO, SDI HD" Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar puertos de entrada de alta definición (HDMI, DISPLAY PORT, DVI, 3G-SDI) compatibles con el videopocesor ofertado ¿Se acepta nuestra propuesta?	DEBERÁ CUMPLIR CON LO SOLICITADO HDMI, DVI, RGB, COMPUESTA, VIC S-VIDEO, SDI HD

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-001/2024
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO MÉDICO TORRE DE ENDOSCOPIA COMPLETA**

11

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
11	Ficha Técnica Monitor LCD 4K de Ultra Alta – Definición Inciso F	La Convocante solicita "Con opción de salidas DVI, S-VIDEO, RGB y compuesto" Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar puertos de Salidas DVI, DISPLAY PORT, 3G-SDI ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE REQUIEREN SALIDAS DVI, S-VIDEO, RGB Y COMPUESTO
12	Ficha técnica Comprobador de impermeabilidad	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar Comprobador de impermeabilidad de acuerdo al fabricante, es decir, de la misma marca y compatible con los endoscopios ofertados, ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SIN MODIFICAR LO SOLICITADO
13	Ficha técnica Sistema de captura de imágenes Inciso A	La Convocante solicita "Equipo de cómputo tipo Workstation 8 GB RAM, DD 2 TB SATA, CD/DVD-RW 8X, puerto serial disponible, Windows 7 Profesional 32 bits, Teclado, Mouse, Tarjeta de red 100/1000 Mbps, Monitor de 17")" Solicitamos a la convocante nos permita ofertar especificaciones técnicas de la computadora de acuerdo al software ofertado con el fin de garantizar la compatibilidad y no limitar la libre participación, ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA OFERTAR EQUIPO COMPATIBLE CON LOS DEMÁS EQUIPOS DE SU OFERTA
14	Ficha técnica Sistema de captura de imágenes Inciso C	La convocante solicita "Unidad de Poder ininterrumpida de 350 VA (UPS 0 no BREAK)" Entendemos que ofertar un UPS de 1500 VA o superior cumple con lo solicitado, ¿Es correcta nuestra apreciación?	QUE CUMPLA COMO MÍNIMO CON LO QUE SE SOLICITA UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA DE 350 VA (UPS 0 NO BREAK)
15	Ficha técnica Sistema de captura de imágenes Inciso D y E	La convocante solicita "d) Licenciamiento de Software SIIIMED" y "e) Tarjeta de Captura para SIIIMED HD" Con la finalidad de no limitar la libre participación solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un software En2soft compatible con la torre de endoscopia ofertada, con el fin de no limitar la participación y garantizar la compatibilidad, ¿Se acepta nuestra propuesta?	PUEDE OFERTAR EL SOFTWARE COMPATIBLE CON EL EQUIPO QUE SE PROPONGAN
16	Ficha técnica Sistema de captura de imágenes Inciso F y G	La Convocante "f) Cable Elite HDMI a DVI-D de 1.8 m" y "g) Computadora Ensamblada sin Monitor" Con la finalidad de no limitar la libre participación solicitamos amablemente a la Convocante que nos permita ofertar especificaciones técnicas del hardware de acuerdo al software ofertado con el fin de garantizar la compatibilidad, ¿Se acepta nuestra propuesta?	PUEDE OFERTAR EL CABLE COMPATIBLE CON EL EQUIPO QUE SE PROPONGAN

Se informa que las solicitudes de aclaración fueron solventadas por la Directora de Servicios Médicos, la Dra. Ma. Guadalupe Garza Sagástegui, así como con el apoyo del personal a su cargo del ISSSTELEON, así como



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000

@gob_Nuevo León    

Handwritten signatures and initials:
Aranda B. M. [initials]

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-001/2024
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO MÉDICO TORRE DE ENDOSCOPIA COMPLETA**

12

también, por el Director de Administración, el Licenciado Juan Enrique Villarreal Salazar, junto con el apoyo del personal a su cargo del ISSSTELEON, cuyas firmas aparecen al final de la presente acta.

En este acto se hace entrega de la versión electrónica de las solicitudes de aclaración mediante medio físico a las personas que así lo entregaron, de conformidad con el artículo 72 párrafo nueve del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

TERCERO.- CIERRE DEL ACTA: De conformidad con el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, esta acta forma parte integrante de la convocatoria y deberá de ser considerada por los licitantes en la elaboración de sus propuestas.

Asimismo, para efectos de la notificación y en términos del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, en la página WEB del ISSSTELEON <http://www.isssteleon.gob.mx>, la presente acta.

A su vez, se recuerda a los licitantes que el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas se llevará a cabo el día **veintiuno de junio del año dos mil veinticuatro** a las **once horas con treinta minutos** en este mismo lugar.

No existiendo aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada esta junta, siendo las **10:28-diez horas con veintiocho minutos** del día al inicio señalado, levantándose el acta correspondiente, firmando la misma para constancia y efectos legales que le son inherentes, las personas que intervinieron en este acto y así quisieron hacerlo, sirviendo la presente acta de notificación legal, entregándose copia de la misma a cada uno de los presentes.

Miembros del Comité de Adquisiciones del ISSSTELEON

Con voz y voto:

Lic. Juan Enrique Villarreal Salazar

Director de Administración del ISSSTELEON

En representación del Lic. Luis Gerardo Gómez Guzmán,

Director General del ISSSTELEON




isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000

@gob_Nuevo León    



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**


**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-001/2024
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO MÉDICO TORRE DE ENDOSCOPIA COMPLETA**

13

Lic. Juan Silvano Hernández Sena

*En representación de la Secretaría de Administración del
Estado de Nuevo León*





Lic. Guillermo Zamora Garza

*Encargado de la Dirección Jurídica y
representante del área jurídica del ISSSTELEON*

Sólo con voz:

C.P. Patricia Graciela Torres Gauna

*Representante de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León*





Dra. Ma. Guadalupe Garza Sagástegui

*Directora de Servicios Médicos del ISSSTELEON
Representante del área que requirió el bien y/o servicio*





Testigo Social

C. Surisadday Campos Hernández

Por los licitantes

DISPOSITIVOS MÉDICOS DEL NORTE, S. DE R.L.

C. Carlos Molina González



MEDICAZEN, S.A. DE C.V.

C. Karla María Valle Barajas



STRYKER MÉXICO, S.A. DE C.V.


C. Azahel Darío Rivera Silva


_____

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-001/2024
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO MÉDICO TORRE DE ENDOSCOPIA COMPLETA**

Monterrey, Nuevo León a 13 de junio de 2024.

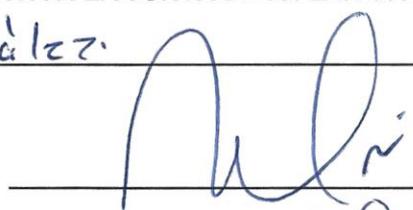1	
NOMBRE DEL LICITANTE:	<u>Dispositivos Medicos del Norte</u>
REPRESENTANTE LEGAL:	<u>Carlos Malina González</u>
NOMBRE DE LA PERSONA QUE SE PRESENTA A LA JUNTA DE ACLARACIONES:	<u>Carlos Malina González</u>
FIRMA:	
CORREO ELECTRÓNICO:	<u>dispositivosmedicosdelnorte@gmail.com</u>
2	
NOMBRE DEL LICITANTE:	<u>MEDICAZEN</u>
REPRESENTANTE LEGAL:	<u>Roberto Javón Jesús Simón Robles</u>
NOMBRE DE LA PERSONA QUE SE PRESENTA A LA JUNTA DE ACLARACIONES:	<u>Karla María Valle Barrera</u>
FIRMA:	
CORREO ELECTRÓNICO:	<u>karla.valle@medicazen.com.mx</u>



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-001/2024
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO MÉDICO TORRE DE ENDOSCOPIA COMPLETA**

Monterrey, Nuevo León a 13 de junio de 2024.

3	
NOMBRE DEL LICITANTE:	<u>Stryker</u>
REPRESENTANTE LEGAL:	<u>Yamileth Pacheco</u>
NOMBRE DE LA PERSONA QUE SE PRESENTA A LA JUNTA DE ACLARACIONES:	<u>Azabel Rivera</u>
FIRMA:	<u>Azabel</u>
CORREO ELECTRÓNICO:	<u>azabeldario.rivera@stryker.com</u>
4	
NOMBRE DEL LICITANTE:	_____
REPRESENTANTE LEGAL:	_____
NOMBRE DE LA PERSONA QUE SE PRESENTA A LA JUNTA DE ACLARACIONES:	_____
FIRMA:	_____
CORREO ELECTRÓNICO:	_____



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-001/2024
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO MÉDICO TORRE DE ENDOSCOPIA COMPLETA**

Monterrey, Nuevo León a 13 de junio de 2024


Miembros del Comité de Adquisiciones del ISSSTELEON

Con voz y voto:

Lic. Juan Enrique Villarreal Salazar

Director de Administración del ISSSTELEON

*En representación del Lic. Luis Gerardo Gómez Guzmán,
Director General del ISSSTELEON*



Lic. Juan Silvano Hernández Sena

*En representación de la Secretaría de Administración del
Estado de Nuevo León*




Lic. Guillermo Zamora Garza

*Encargado de la Dirección Jurídica y
representante del área jurídica del ISSSTELEON*



Sólo con voz:

C.P. Patricia Graciela Torres Gauna

*Representante de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León*



Dra. Ma. Guadalupe Garza Sagástegui

*Directora de Servicios Médicos del ISSSTELEON
Representante del área que requirió el bien y/o servicio*



Testigo Social

C. Surisadday Campos Hernández


_____