

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-002/2026
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

1

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León siendo las **diez horas con treinta y cuatro minutos** del día **doce de febrero del año dos mil veintiséis**, en la Sala de Consejo del ISSSTELEON, ubicada en calle Mariano Matamoros 319 Poniente, en el Centro de esta Ciudad; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria del procedimiento de licitación arriba mencionado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, 72 y 73 de su Reglamento, así como del numeral 6 de la convocatoria de licitación.

Presidiendo este acto el **Lic. Juan Enrique Villarreal Salazar**, Director de Administración y Presidente del Comité de Adquisiciones del ISSSTELEON, quien procede a dar continuación a la sesión de junta de aclaraciones; informando a los licitantes presentes que de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, de forma presencial y cuyas preguntas hayan sido recibidas con **24-veinticuatro horas** de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

PRIMERO.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM: Vista la lista de asistencia de la presente sesión se verifica y da fe por parte del Subdirector Jurídico Consultivo y suplente del representante del área jurídica del ISSSTELEON, el **Lic. Héctor Salvador Molina Hernández**, que de conformidad con el artículo 18, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, se encuentra presente la totalidad de los integrantes del Comité de Adquisiciones con derecho a voz y voto, así como los invitados a esta junta de aclaraciones, por lo que los acuerdos tomados en la presente sesión son válidos y subsistentes para todos los efectos legales.

SEGUNDO.- ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES: El Presidente del acto, hace constar que de conformidad al artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y el numeral 6 de la convocatoria, se recibieron en tiempo y forma las solicitudes de aclaración, así como el escrito de interés en participar, de los siguientes licitantes:



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000

@gob_Nuevo León



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-002/2026
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

2

No.	Nombre (Razón o Denominación Social)	Número de solicitudes de aclaramción
1	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	14
2	KABLA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	13
TOTAL DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN		27

Acto seguido, se procede a la lectura de las solicitudes de aclaración a la convocatoria, presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la convocante, como se indica a continuación:

COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.

A. PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
1	III.2 Medio y carácter de la licitación	Se menciona que la presente licitación es de carácter Nacional Presencial, en la que solamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y los productos y/o servicios a adquirir sean producidos en el país y que cuenten con por lo menos, con un cincuenta por ciento de contenido nacional. A este respecto, Los Reactivos solicitados para Equipo en Comodato, tales como "Ácido Úrico", "Albumina", "Amilasa" etc. y los equipos en comodato que se mencionan en la ficha técnica para los mismos, no son producidos en México y por lo tanto no cumplen con el requisito de contar con por lo menos el cincuenta por ciento de contenido nacional, por lo que solicitamos a la convocante nos aclare si ¿Será posible ofertar bienes que provienen de países con los que México ha establecido tratados comerciales?	Es posible ofertar siempre y cuando presente los permisos de importación
2	8.2 Documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, 8.2.9.	Se solicita escrito bajo protesta de decir verdad que somos de nacionalidad mexicana y, en el caso de adquisición de bienes, además manifestará que los bienes que oferta y entregará, serán producidos en México y contarán con el porcentaje de contenido nacional correspondiente, de acuerdo al formato Anexo 9. A este respecto, los bienes que se solicitan en esta licitación no cumplen con el grado de integración nacional solicitado, por lo que solicitamos a la convocante nos permita presentar el Anexo 9, solamente	Se acepta, además, deberán presentarse los permisos de importación



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000

@gob_Nuevo León



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-002/2026
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

3

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
		manifestando que somos de nacionalidad mexicana. ¿Se acepta esta propuesta?	
3	8.2 Documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, 8.2.25.	Se solicita Copia Simple de los Registros Sanitarios de los Equipos Analizadores, pero no se solicita Copia Simple de Registro Sanitario de los Reactivos. ¿Es correcto que solamente se entregará copia simple del Registro Sanitario de los Equipos? Favor de aclarar.	Se requiere copia simple del registro sanitario de equipos analizadores y reactivos
4	8.2 Documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, 8.2.17.	Se solicita Currículum actualizado del licitante. a) Una relación de las principales operaciones de venta o prestación de servicios de los últimos doce meses, que incluya un informe técnico de los mismos, adjuntando las constancias de cumplimiento expedidas por los clientes del licitante. A este respecto, ¿Sería suficiente con enlistar solamente a tres de nuestros clientes principales, describir el objeto del (los) contratos y mencionar el importe del (los) contratos que se tengan con ellos? Favor de aclarar.	Se deberá de entregar de acuerdo a lo señalado en el numeral 8.2.17 de la convocatoria
5	8.2 Documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, 8.2.17.	Se solicita Currículum actualizado del licitante. c) La indicación de los títulos de estudios y profesionales de los responsables de la producción de los bienes o de la prestación de servicios. A este respecto, ¿Sería suficiente con enlistar el título profesional del personal de Soporte Técnico encargado de darle servicio a los equipos en comodato? Favor de aclarar.	Se deberá de entregar de acuerdo a lo señalado en el numeral 8.2.17 de la convocatoria
6	8.2 Documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, 8.2.23 y Anexo 19.	Se solicita adjuntar copia del certificado del curso de prevención y concientización sobre faltas administrativas y hechos de corrupción y además, adjuntar "el documento completo que se genera en la página de interés antes señalada". A este respecto, la liga de internet solamente genera la constancia del curso, Entendemos que la mención que se hace al "documento completo que se genera" se refiere solamente al certificado del curso. ¿Es correcta esta apreciación?	Es correcta su apreciación
7	8.2 Documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, 8.2.27.	Se solicita Anexos Técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante para comprobar las especificaciones técnicas requeridas. A este respecto, ¿Sería suficiente con proporcionar solamente las hojas de manual en dónde se hace referencia a la especificación requerida? Lo anterior debido a que algunos manuales cuentan con 500-1000 hojas, todas las cuáles no son necesarias para comprobar las especificaciones. Favor de aclarar.	Se acepta su propuesta, <u>adjuntando</u> en medio magnético USB, los Anexos Técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante <u>completos</u> y de acuerdo a lo señalado en el numeral de referencia



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000

@gob_Nuevo León



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-002/2026
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

4

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
8	8.2 Documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, 8.2.27.	En dado caso de que la respuesta a la solicitud anterior sea negativa, Solicitamos atentamente a la convocante nos permita entregar los manuales de los equipos en medio electrónico (CD o USB) para cumplir con este requisito. ¿Se acepta esta propuesta?	La respuesta no fue negativa
9	8.2 Documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, 8.2.30.	Se solicita Copias simples de constancias o certificados por parte del fabricante de los equipos expedidos a nombre del personal de soporte técnico, para acreditar el dominio de herramientas relacionadas con el servicio... Así mismo, incluir una copia simple del documento de movimientos afiliatorios que demuestre que forma parte de la planilla de personal del licitante. A este respecto, si bien mi representada cuenta con Ingenieros de Soporte debidamente capacitados por el fabricante, para proporcionar un servicio más eficiente, personal del fabricante puede apoyar para dar soporte y mantenimiento a sus equipos. En tal caso, solicitamos a la convocante nos permita incluir además, las constancias del personal de Ingeniería del Fabricante que pudiera prestar el servicio en caso de ser necesario. ¿Se acepta esta propuesta?	Se acepta la propuesta de que el personal del fabricante brinde apoyo en el soporte y mantenimiento de los equipos.

B. PREGUNTAS TÉCNICAS

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
1	Ficha Técnica, Reactivos para Laboratorios y Equipos en Comodato 2026. Especificaciones Técnicas del Equipamiento. EQUIPO Coagulación	Solicitan la determinación de la prueba de Fibrinógeno de Clauss e indican que se deberá incluir en cada solicitud de Tiempo de Protrombina (TP) y Tiempo de tromboplastina (TTP), se entiende que sólo se tomará en cuenta una determinación de Fibrinógeno de Clauss en los casos en los que sólo se pida un Tiempo de Protrombina o un Tiempo de Tromboplastina Parcial, ¿es correcta nuestra observación?	Es correcta la observación
2	Ficha Técnica, Reactivos para Laboratorios y Equipos en Comodato 2026. Especificaciones Técnicas del Equipamiento. EQUIPO HORMONAS Y ESTUDIOS ESPECIALES.	En las Especificaciones de Equipo para este grupo se menciona una capacidad de 200 a 400 estudios/hra. Tomando en cuenta que para estos estudios especiales se establece que se deberán "Instalar los equipos necesarios en las áreas que el Instituto designe para la realización de los estudios especiales, en caso que la productividad o logística así lo requiera" ¿se puede ofertar un equipo complementario por	Si se acepta la propuesta para los estudios especiales de los renglones 58, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 77, 78, 81, 84, 87 y 88.



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000

@gob_Nuevo León



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-002/2026
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

5

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
	Renglones 58, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 77, 78, 81, 84, 87 y 88.	Quimioluminiscencia con capacidad de 60 pruebas por hora para los renglones especificados? ¿Se acepta?	
3	Ficha Técnica, Reactivos para Laboratorios y Equipos en Comodato 2026. Especificaciones Técnicas del Equipamiento. EQUIPO HORMONAS Y ESTUDIOS ESPECIALES. Renglones 68, 79 y 80	En las Especificaciones de Equipo para este grupo se menciona una capacidad de 200 a 400 estudios/hra. Tomando en cuenta que para estos estudios especiales se establece que se deberán "Instalar los equipos necesarios en las áreas que el Instituto designe para la realización de los estudios especiales, en caso que la productividad o logística así lo requiera" ¿se puede ofertar un microscopio de epifluorescencia con iluminación LED y objetivos 10x, 20x y 40x? ¿Se acepta?	Se acepta la propuesta
4	Ficha Técnica, Reactivos para Laboratorios y Equipos en Comodato 2026. LISTADO DE ESTUDIOS, GRUPO GASES EN SANGRE. Renglón 44 Gases en Sangre (co-oximetría).	En las Especificaciones de Equipo Gases y PH en Sangre solo se enlistan los siguientes analitos a determinar: pH, pO2, pCO2, HCO3, EB, Lactato, SO2 y CO2t. ¿Se requiere la determinación de gases con Co-oximetría? Favor de aclarar	No se requiere, es necesario que se determinen los analitos pH, pO2, pCO2, HCO3, EB, Lactato, SO2 y CO2t.
5	Ficha Técnica, Reactivos para Laboratorios y Equipos en Comodato 2025. LISTADO DE ESTUDIOS, GRUPO SEROLOGÍAS. Renglón 52 Prueba FIT (IFOB).	Para esta determinación ¿necesitan una prueba cualitativa, semicuantitativa o cuantitativa? Favor de aclarar y favor de confirmar las cantidades de estudios solicitadas	Se requiere prueba cualitativa y la cantidad de estudios máximos y mínimos se presenta en el renglón 52 del listado de estudios

KABLA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

A. PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
1	III.2 Medio y carácter de la licitación. Deberán ser de origen nacional o de los países miembros de los Tratados de Libre Comercio con capítulo de compras gubernamentales,	Solicitamos a la convocante nos corrobore, si Todos los Bienes de Consumo, que en el caso de resultar Adjudicado considerar en nuestra propuesta la Partida completa y deberán ser originales y presentarse listos para ser utilizados, los cuales deberán ser compatibles con los equipos que oferten para la prestación del servicio y corresponderá a los niveles necesarios para obtener resultados precisos, de acuerdo con lo manifestado por el fabricante del producto. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Tanto los reactivos de laboratorio como los equipos en comodato deben cumplir con las especificaciones de la ficha técnica, así como a las modificaciones o precisiones establecidas en la presente junta de aclaraciones.



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000

@gob_Nuevo León



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-002/2026
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

6

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
	vigentes suscritos por México.		
2	III.2 Medio y carácter de la licitación	Si la respuesta anterior es positiva debemos entender que podremos ofertar bienes de origen Chino cumpliendo con los lineamientos de calidad, sin limitar la libre participación. ¿Se acepta?	Tanto los reactivos de laboratorio como los equipos en comodato deben cumplir con las especificaciones de la ficha técnica, así como a las modificaciones o precisiones establecidas en la presente junta de aclaraciones.
3	Numeral 2 Plazo, lugar y condiciones de entrega. Solicitan en la noveno párrafo entrega de a más tardar 30 días,	Solicitamos a la convocante nos permita una entrega de 30 días naturales, con la finalidad de no limitar la libre participación. ¿Se acepta?	Se deberá realizar de acuerdo a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria en concordancia con el numeral 2. ADECUACIÓN DEL ÁREA FÍSICA de la ficha técnica.

B. PREGUNTAS TÉCNICAS

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
1	8 forma de presentación de la propuesta Técnica y Económica y documentos esenciales que deberá contener el sobre Técnico y el Económico. Punto 8.2.25 copia de Registro sanitario	Solicitamos a la convocante que debemos entender que la copia simple del registro sanitario deberá contar con el No. consecutivo al pie del registros sanitario donde se pueda corroborar la vigencia del Registro sanitario y en caso de vencimiento adjuntar copia simple de la solicitud de prórroga que fue sometido en tiempo y forma con su comprobante de pago. ¿Es correcta nuestra apreciación?	En caso de contar con el registro vencido, deberá presentar: Copia simple del oficio de registro sanitario sometido a prórroga. b) Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del registro sanitario presentado ante de la COFEPRIS, especificando claramente el número de registro sanitario al que pertenece el recibo.
2	8 forma de presentación de la propuesta Técnica y Económica y documentos esenciales que deberá contener el sobre Técnico y el Económico. Punto 8.2.26	Solicitamos a la convocante en caso de presentar original, o copia simple del aviso de funcionamiento y responsable sanitario solicitamos a la convocante no permita presentarlos en un porta hojas. ¿Se acepta?	No se acepta



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000

@gob_Nuevo León



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-002/2026
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

7

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
3	8 forma de presentación de la propuesta Técnica y Económica y documentos esenciales que deberá contener el sobre Técnico y el Económico. Punto 8.2.26	Entendemos que para aquellos productos considerados de bajo riesgo podemos presentar la publicación del DOF vigente publicado por la COFEPRIS* Listado de insumos para la salud considerados como bajo riesgo, para efectos de obtención del registro sanitario y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y usos no se consideran como insumo para la salud y por no requerir registro sanitario? ¿Es correcta nuestra apreciación?	No es correcta su apreciación, se deberá de entregar la documentación e información solicitada en el numeral de referencia
4	Ficha Técnica Reactivos para Laboratorio y Equipos en Comodato 2026. Condiciones de la presentación del servicio. 2. Adecuaciones del área física, y 2. Adecuaciones del área física y entrega física.	Debemos entender que para dar cumplimiento con este punto bastará con presentar las guías mecánicas con carta bajo protesta de decir que en caso de que se requieran adecuaciones eléctricas, mi representada dará cumplimiento con dicha adecuación. ¿Se acepta?	No se acepta, apegarse a ficha técnica
5	Ficha Técnica Reactivos para Laboratorio y Equipos en Comodato 2026. El servicio y la cantidad requerida por el convocante, es enunciativo más no limitativo y se describe a continuación	Solicitamos a la convocante nos aclare si las cantidades mínima y máxima son Mensuales o anuales, de acuerdo al 2025 era mayor el número de pruebas anuales. ¿Es correcta nuestra apreciación?	No es correcta su apreciación, apegarse a ficha técnica
6	Ficha Técnica Reactivos para Laboratorio y Equipos en Comodato 2026. El servicio y las cantidades requeridas por el convocante, es enunciativo más no limitativo y se describe a continuación.	Solicitamos a la convocante que para aquellos estudios que están por debajo de entre 4 y 20 y 150 a 300 prueba estamos procesando, mas calibraciones y controles y costo por prueba se encarece, ejemplo Capacidad de fijación de hierro (Captación), prueba Hormona y especiales realiza de 4 a 9 y/o 32 a 80 al año, podremos enviar a laboratorio de Referencia. ¿Se acepta?	Se acepta la propuesta
7	Ficha Técnica Reactivos para Laboratorio y Equipos en Comodato 2026. El servicio y las cantidades requeridas por el convocante, es enunciativo más no limitativo y se describe a continuación.	No. 150 Grupo Hormonas Especiales estudio Troponina T, solicitamos a la convocante nos permita ofertar Troponina I con la finalidad de no limitar la libre participación ¿Se acepta?	Se acepta la propuesta
8	Especificaciones para Gases en Sangre. Control externo mínimo a tres niveles, deberá incluir cuando menos uno de: acidosis, alcalosis o	Solicitamos amablemente a La convocante nos permita ofertar analizador de Gases en Sangre el cual realiza su control de calidad interno con mínimo 3 niveles a realizar su control de interno con diferentes concentraciones, las cuales simulan los estados clínicos de	Se acepta la propuesta



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000

@gob_Nuevo León



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-002/2026
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

8

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
	normal. Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los controles.	los pacientes como son: alto, bajo y normal también llamados Acidosis y Alcalosis y normal ¿Se acepta?	
9	Especificaciones para el estudio de VPH por PCR. El estudio debe incluir la detección del papiloma humano en pool de los 50 tipos de VPH de riesgo alto, intermedio y bajo asociados a infecciones anogenitales con investigación de los genotipos de alto riesgo 16 y 18 en muestras positiva en caso de ser positivos para VPH.	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar son 24 genotipos solo de alto riesgo. Sin limitar la libre participación. ¿Se acepta?	No se acepta, apegarse a lo solicitado en ficha técnica
10	Especificaciones para el estudio de VPH por PCR. El estudio debe incluir la detección del papiloma humano en pool de los 50 tipos de VPH de riesgo alto, intermedio y bajo asociados a infecciones anogenitales con investigación de los genotipos de alto riesgo 16 y 18 en muestras positiva en caso de ser positivos para VPH.	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar 32 genotipos. Si tiene alto, intermedio y bajo riesgo. Sin limitar la libre participación. ¿Se acepta?	No se acepta, apegarse a lo solicitado en ficha técnica

Se informa que las solicitudes de aclaración fueron solventadas por la Directora de Servicios Médicos del ISSSTELEON, la Dra. Ma. Guadalupe Garza Sagástegui, así como con el apoyo del personal a su cargo del ISSSTELEON, cuya firma aparecen al final de la presente acta.

En este acto se hace entrega de la versión electrónica de las solicitudes de aclaración mediante medio físico a las personas que así lo entregaron, de conformidad con el artículo 72 párrafo nueve del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

TERCERO.- CIERRE DEL ACTA: De conformidad con el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, esta acta forma parte integrante de la convocatoria y deberá de ser considerada por los licitantes en la elaboración de sus propuestas.



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000

@gob_Nuevo León    

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-002/2026
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

9

Asimismo, para efectos de la notificación y en términos del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, en la página WEB del ISSSTELEON <http://www.isssteleon.gob.mx>, la presente acta.

A su vez, se recuerda a los licitantes que el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas se llevará a cabo el día **veinte de febrero del año dos mil veintiséis** a las **diez horas con treinta minutos** en este mismo lugar.

No existiendo aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada esta junta, siendo las **diez horas con cincuenta minutos** del día al inicio señalado, levantándose el acta correspondiente, firmando la misma para constancia y efectos legales que le son inherentes, las personas que intervinieron en este acto y así quisieron hacerlo, sirviendo la presente acta de notificación legal, entregándose copia de esta a cada uno de los presentes.

Miembros del Comité de Adquisiciones del ISSSTELEON

Con voz y voto:

Lic. Juan Enrique Villarreal Salazar


*Director de Administración y Presidente del
Comité de Adquisiciones del ISSSTELEON*

Lic. Juan Silvano Hernández Sena

*En representación de la Secretaría de Administración de
Estado de Nuevo León*

Lic. Héctor Salvador Molina Hernández

*Subdirector Jurídico Consultivo y suplente del
representante del área jurídica del ISSSTELEON*

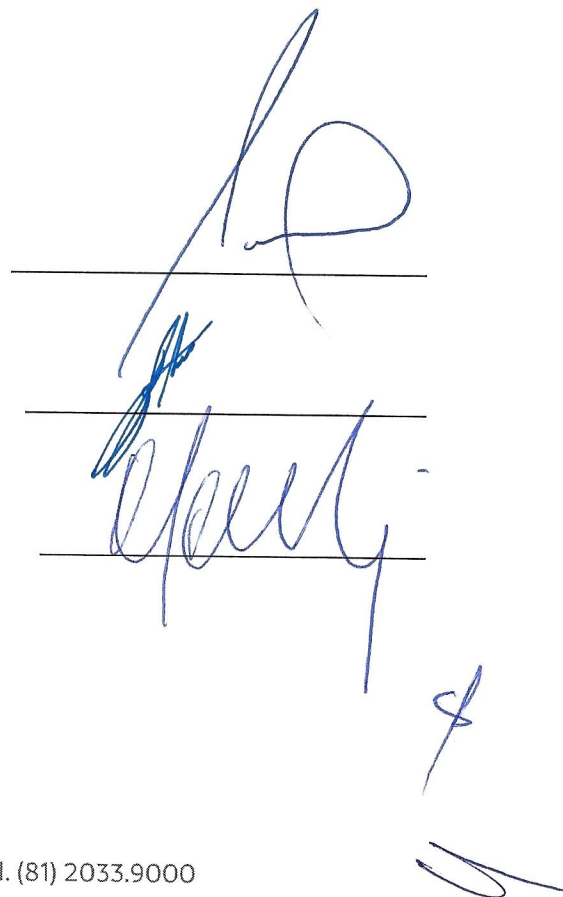

isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000

@gob_Nuevo León    

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-002/2026
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

10

Sólo con voz:

Lic. Yadira Faz Cedillo

Representante de la Contraloría y

Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León

"Dejando salvaguardadas las facultades de verificación y comprobación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental"



Dra. Ma. Guadalupe Garza Sagástegui

Directora de Servicios Médicos del ISSSTELEON

Representante del área que requirió el bien y/o servicio



Por los licitantes


**COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.**

C. René Gerardo Salazar Robledo



KABLA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

C. Iván Arturo Hernández Escobedo

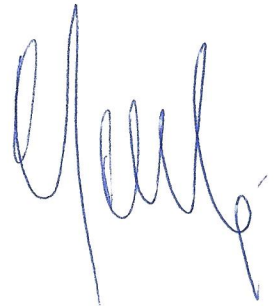

isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000

@gob_Nuevo León



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN****LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-002/2026
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO**

Monterrey, Nuevo León a 12 de febrero de 2026.

1	
NOMBRE DEL LICITANTE:	<u>Comercializadora de Reactivos para Laboratorios y Materiales para Hospitales, S.A. de C.V.</u>
REPRESENTANTE LEGAL:	<u>Rene Gerardo Salazar Robledo</u>
NOMBRE DE LA PERSONA QUE SE PRESENTA A LA JUNTA DE ACLARACIONES:	<u>Rene Gerardo Salazar Robledo</u>
FIRMA:	
CORREO ELECTRÓNICO:	<u>rsalazar@creclmh.com</u>
2	
NOMBRE DEL LICITANTE:	<u>Kahla Comercial SA de CV</u>
REPRESENTANTE LEGAL:	<u>Aydee Leticia Ortega Contreras / Ivan Hernandez Escobedo</u>
NOMBRE DE LA PERSONA QUE SE PRESENTA A LA JUNTA DE ACLARACIONES:	<u>Ivan Arturo Hernandez Escobedo</u>
FIRMA:	
CORREO ELECTRÓNICO:	<u>ivan.hernandez@kaha.mx</u>



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN****LISTA DE ASISTENCIA A LA ETAPA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-002/2026
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

Monterrey, Nuevo León a 12 de febrero de 2026

**Miembros del Comité de Adquisiciones del ISSSTELEON
Con voz y voto:****Lic. Juan Enrique Villarreal Salazar***Director de Administración y Presidente del
Comité de Adquisiciones del ISSSTELEON***Lic. Juan Silvano Hernández Sena***En representación de la Secretaría de Administración de
Estado de Nuevo León***Lic. Héctor Salvador Molina Hernández***Subdirector Jurídico Consultivo y suplente
del área jurídica del ISSSTELEON***Sólo con voz:****Lic. Yadira Faz Cedillo***Representante de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León***Dra. Ma. Guadalupe Garza Sagástegui***Directora de Servicios Médicos del ISSSTELEON
Representante del área que requirió el bien y/o servicio***Testigo Social**

C. _____



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000

@gob_Nuevo León

